FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

EN

Gomme polie & Caoutchouc vulcanisé

ASEPTIQUES, STÉRILISABLES & INALTÉRABLES EN TOUS PAYS

Ancienne Maison GAILLARD & REQUIER, fondée en 1890



L. GAILLARD

PARIS — 4, Quai des Orfèvres, 4 — PARIS

FOURNISSEUR AU CHOIX :

Des Hôpitaux de Paris, des Hôpitaux Civils et Militaires,
Des Etablissements de Bienfaisance de l'Assistance publique, des Ministères de la Guerre, de la Marine et de l'Intérieur
Fournisseur de l'Hôpital Necker (Salles des Maladies des voies urinaires de M. le Professeur Guyon)
Seul Fournisseur titulaire de l'Hôpital Général de Mexico et de plusieurs Facultés Françaises et Etrangères.

PREMIER PRIX : MÉDAILLE D'ARGENT

Bordeaux 1895 — Bruxelles 1897

CATALOGUE ILLUSTRÉ

1899



USINE A ALFORVILLE (SEINE)

AVIS TRÈS IMPORTANT

Avantages des Sondes et Bougies marquées « L. GAILLARD »

Toutes nos Sondes et Bougies sont recouvertes de notre gomme spéciale, élastiques et flexibles ; elles offrent une surface polie glacée. Toutes nos Sondes sont à œil tissé grand diamètre intérieur et à bout plein aseptique ; celles en tissu de soie ont une souplesse égale à celles en caoutchouc, avec cet avantage d'un diamètre intérieur très large ; elles sont aseptiques, à surface interne lisse, stérilisables par l'ébullition ou tout autre procédé désinfectant ; notre gomme, de qualité inaltérable, se conserve parfaitement dans tous les pays.

Nos clients peuvent aussi se procurer nos produits chez MM. les Fabricants ou Marchands d'instruments de Chirurgie, les Bandagistes-Orthopédistes et dans les bonnes maisons d'Herboristerie, de Droguerie et Pharmacie de tous pays.

Seule la marque « **L. GAILLARD** » offrant toutes garanties, l'exiger sur chaque instrument.

Toute première commande devra être accompagnée d'un mandat sur la poste ou d'un chèque à vue sur Paris, ceci pour éviter les frais de retour d'argent ou du retard dans la livraison.

Les envois par poste comme échantillon sans valeur voyagent aux risques et périls du destinataire.

Nos marchandises sont payables en francs effectifs or.

Les prix du présent catalogue sont exclusivement réservés pour les affaires de gros.

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

CATALOGUE GÉNÉRAL ILLUSTRÉ

DES

INSTRUMENTS EN GOMME POLIE ET CAOUTCHOUC VULCANISÉ

Chirurgie, Médecine, Hygiène

L. GAILLARD

BREVETÉ S. G. D. G.

4, Quai des Orfèvres, PARIS (pont Saint-Michel)

FOURNISSEUR AU CHOIX DES HOPITAUX DE PARIS

Seul Fournisseur titulaire de l'Hôpital général de Mexico

Maladies des voies urinaires

Instruments pour Exploration et Diagnostic



Fig. 1

1 **Bougie** à boule exploratrice, percée, pour *instillations*, du professeur Guyon (fig. 1) . . . . la douz. **15** »

2 **Bougie** à boule *exploratrice* de Leroy (fig. 2) . . . . la douz. **15** »



Fig. 2

3 **Bougie** à boule exploratrice et ovalaire de Guyon et Leroy, modèle Gaillard (fig. 2) . . . . la douz. **15** »

Les deux boules de cette bougie sont d'un même numéro indiqué sur la boule de forme ovalaire, qui présente ce double avantage, de laisser intacte la boule exploratrice dont on se sert le plus souvent et permet de faire plus facilement le diagnostic entre le spasme uréthral et le rétrécissement traumatique. Leçons-Clinique M. le professeur Guyon à l'hôpital Necker. . . . .

4 **Explorateur** (fig. 2). Le même que ci-dessus, la tige graduée de centimètre en centimètre, indiquant ainsi très exactement la distance où se trouvent les retrécissements. . . . . la pièce. **2** »



Fig. 3

5 **Explorateur** conduit du Dr Janet (fig. 3) ou à boule coupé d'angle, comme fig. 2. . . . . la douz. **30** »



Fig. 4

6 **Bougie** conique olivaire à boule exploratrice du Dr Mallez (fig. 4) . . . la douz. **18** »



Fig. 5

7 **Bougie** à trois olives successives de Mallez (fig. 5) . . . . la douz. **24** »
8 **Bougie** à quatres olives successives du Dr Mallez. . . . . la douz. **30** »



Fig. 6

9 **Bougie** exploratrice à deux boules graduées de Gaillard (fig. 6) . . . la douz. **21** »



Fig. 7

10 **Tige** intérieur métallique, à boule exploratrice, nos 3 à 12 . . . . . . la douz. **18** »



Fig. 8

11 **Bougie** à boule exploratrice nos 3 à 12; la tige tissée en soie et crins de florence à l'intérieur, d'une grande élasticité, transmet facilement les sensations produites par la partie antérieure fig. 8, modèle Gaillard. (fig. 8). . . la douz. **18** »
12 **Explorateur** à boule ovalaire de Pouchet. . . . . la douz. **12** »



Fig. 9

13 **Explorateur** lancéole du Dr Hamonic, ayant une grande élasticité, donne une répercussion très sensible, modèle Gaillard (fig. 9) . . . . la douz. **24** »



Fig. 10

14 **Explorateur** pariétal du Dr Hamonic, indiquant si le rétrécissement est placé en haut, en bas, à droite ou à gauche, modèle Gaillard (fig. 10) . . . la douz. **30** »



Fig. 11

15 **Bougie** filiforme olivaire en baleine du Dr Reliquet (fig. 11) . . . . . la douz. **15** »



Fig. 12

16 **Bougie** double, olivaire en baleine et olivaire en soie (fig. 12) . . . . la douz. **30** »



Fig. 13

17 **Bougie** en baleine à béquille du Dr Mercier (fig. 13) . . . . la douz. **15** »

L.GAILLARD

Fig. 14

18 **Bougie** filiforme olivaire en baleine, tortillée en spirale (fig. 14) . . . la douz. 18 »

Fig. 15

18 *b* **Bougie** filiforme olivaire en baleine tortillée, en baïonnette (fig. 15). . la douz. 18 »

L.GAILLARD (PARIS)

Fig. 16

19 **Bougie** olivaire filiforme, tissée en soie, à intérieur crins de Florence, modèle Gaillard (fig. 16). . . . . la douz. 18 »
Ces bougies sont livrées tortillées en spirale ou en baïonnette du professeur Guyon, sans augmentation de prix . . . . 18 »

20 **Bougie** olivaire en baleine, à trois saillies variées, du D[r] Guillon . . . . chaque 4 50

21 **Bougie** graduée, porte-empreinte de Ducamp, pour constater la présence de calculs ou corps étrangers dans l'urèthre . . . . pièce 3 »

22 **Bougie** en cire, blanche ou rose . . . . douz. 6 »

23 **Sonde** uréthrographique explorative du D[r] Hamonic . . . . pièce 5 »

Instruments destinés à franchir les rétrécissements

Tous ces instruments tissés en soie capillaire

L.GAILLARD

Fig. 17

24 **Bougie** filiforme olivaire, tissée en soie (fig. 17) . . . . douz. 12 »

L.GAILLARD

Fig. 18

25 **Bougies** filiformes coniques (fig. 18). . . . . douz. 12 »

L.GAILLARD

Fig. 19

26 **Bougie** filiforme cylindrique (fig. 19) . . . . douz. 10 50

L.GAILLARD

Fig. 20

27 **Bougie** filiforme olivaire collodionnée en forme de baïonnette du professeur Guyon (fig. 20) . . . . douz. 13 50



Fig. 21

28 **Bougie** filiforme olivaire, collodionnée, en forme spirale (fig. 21) . . . . . douz. **13 50**



Fig. 22

29 **Bougie** olivaire filiforme armée, conducteur pour béniqué de Guyon (fig. 22). douz. **24** »



Fig. 23

30 **Bougie** olivaire filiforme armée, conducteur pour l'uréthrotomie, modèles des professeurs Guyon et Albarran (fig. 23). . . . . douz. **24** »

Toutes nos bougies armées sont fortement soutenues et renforcées à la base par de fortes racines anglaises ou crins de Florence; elles ne peuvent casser à l'usage de conducteurs pour béniqué ou uréthrotome.




Fig. 24

31 **Bougie** filiforme olivaire tissée en soie et crin de Florence à l'intérieur, modèle Gaillard (fig. 24). . . . . la douz. **18** »

32 **Bougies** filiformes olivaires, intérieur crin de Florence, tortillées en spirale ou forme baïonnette du professeur Guyon, modèle Gaillard . . . . la douz. **18** »

Cette bougie filiforme, munie d'un crin de Florence dans sa longueur totale, est, indépendamment de sa qualité, suffisamment rigide, formant ressort et d'une grande élasticité, ce qui permet plus facilement de recueillir toutes les sensations éprouvées par la partie antérieure.

Faite d'après un procédé exclusif de notre Maison, et d'une solidité indiscutable, on peut lui donner instantanément toutes les formes, soit tortillée en spirale ou en forme baïonnette du professeur Guyon, qu'elle conservera sans qu'il soit utile de l'enduire d'une solution de collodion, ce qui augmente la grosseur de l'instrument juste à l'endroit où il doit être le plus fin; de plus, l'on peut ensuite, s'il y a lieu, modifier la forme de notre bougie en contrariant légèrement celle qu'on lui aurait imprimée.

Ces bougies sont livrées tortillées à la demande, sans augmentation de prix.

33 La bougie ci-dessus, armée pour conducteur de béniqué ou d'uréthrotome (voir fig. 22 et 23). . . . . la douz. **30** »



Fig. 25

34 **Bougie** filiforme olivaire, tissée en soie et fil métallique à l'intérieur, modèle du Docteur P. Bazy (fig. 25). . . . . la douz. **15** »

35 **Bougie** filiforme olivaire en baleine. . . . . la douz. **12** »

Fig. 26

36 **Bougie** conique olivaire en baleine du Dr Reliquet, du no 1 au no 6 (fig. 26). . . . . la douz. 15 »

Fig. 27

37 **Bougie** olivaire en baleine et à béquille du Dr Mercier (fig. 27). . . . . 15 »

Fig. 28

38 **Bougie** conique olivaire en baleine, tortillée en forme baïonnette ou spirale (fig. 28). . . . . la douz. 15 »

39 **Bougie** en baleine filiforme, conique et olivaire aux deux extrémités. . la douz. 18 »

Fig. 29

40 **Bougie** double, conique olivaire en baleine et olivaire en tissu de soie, modèle Gaillard (fig. 29). . . . . la douz. 30 »

La série de ces bougies, modèle Gaillard, no 3 à 6, 6 bougies. . . . . 15 »

Nous construisons cette bougie uréthrale en ajoutant sur la partie en baleine une autre partie en gomme souple; ces deux portions distinctes sont solidement fixées par notre système de greffage employé pour la construction de nos conducteurs pour sondes urétérales du Professeur J. Albarran.

Avec cette bougie, le praticien aura ainsi en main un instrument réunissant les qualités suivantes: d'un côté, souplesse et solidité de la bougie en tissu de soie, et de l'autre, la flexibilité et la consistance de la bougie filiforme en baleine.

41 **Bougie** cylindro-conique olivaire, fil de zinc à l'intérieur, du Dr Schmith, no 3 à 9. . . . . la douz. 15 »

42 **Bougie** olivaire à ressort métallique, intérieur modèle Gaillard, no 4 à 12. . la douz. 18 »

43 **Bougie** à bout filiforme, olivaire, de 6 grosseurs différentes commençant au no 3 pour finir au no 9 . . . . la pièce 4 »

44 **Bougie** conductrice, double de longueur, du Dr Philips, du no 1 au no 6. la douz. 30 »

45 **Bougie** conductrice invaginée dans une sonde à boule excentrique (fig. 30), la pièce 4 50

Fig. 30

46 **Bougie** conductrice invaginée dans une sonde à boule, de Guyon . . . . 4 »

47 **Sonde** droite, cylindro-conique percée du bout, pour préparer à franchir les rétrécissements à l'aide d'une colonne de liquide . . . . la douz. 12 »

48 **Bougie** fine olivaire en crin de Florence, modèle Gaillard. . . . . . . la douz. 12 »

Instruments pour la dilatation des rétrécissements

Bougies uréthrales en général



Fig. 31

49 **Bougie** conique olivaire de M. le Dr Guillon (fig. 31) . . . . la douz. **12** »



Fig. 32, à cône moyen



Fig. 33, à cône court

Sauf indication spéciale, nous livrerons toujours ces bougies, le cône allongé (fig. 31), modèle **1**.



Fig. 34

50 **Bougie** conique (fig. 34). . . . . la douz. **11** »



Fig. 35

51 **Bougie** droite cylindrique (fig. 35) . . . . la douz. **7 50**

52 **Bougie** olivaire intérieur grenaille de plomb, en gomme blonde, consistante et de grande souplesse . . . . la douz. **15** »

53 **Bougie** cylindrique, intérieur plomb . . . . la douz. **12** »



Fig. 36

54 **Bougie** conique olivaire à extrémité très souple, modèle Gaillard (fig. 36), la douz. **15** »

Ces bougies sont indiquées plus particulièrement pour dilater les rétrécissements compliqués d'hypertrophie de la prostate.



Fig. 37

55 **Bougie** conique olivaire à extrémité très souple, intérieur grenaille de plomb (fig. 37) . . . . la douz. **18** »




Fig. 38

56 **Bougie** conique olivaire tissée en soie (fig. 38) . . . . la douz. **18** »

Cette bougie, par sa grande souplesse, convient plus particulièrement aux urèthres sensibles ou facilement irritables ; dans ces différents cas, elle est exclusivement recommandée par M. le professeur J. Albarran (voir notice).

57 **Bougie** conique olivaire, intérieur tige de plomb . . . la douz. **18** »

Par ce dispositif, nous obtenons un instrument souple et malléable, auquel l'on peut imprimer instantanément toutes les formes désirables.

58 **Bougie** conique olivaire, intérieur mercure. . . la douz. 18 à **30** »

Les bougies ainsi préparées sont d'une grande souplesse, et d'un poids considérable facilitant le cathétérisme ; maintenues dans la verticale, elles pénètrent seules sans aucune pression : le prix varie suivant la grosseur ou la quantité de mercure contenu.

59 **Bougie** conique olivaire à grande courbure de Gelly (fig. 39). . . . . la douz. **15** »



Fig. 39

60 **Bougie** cylindrique courbe de Gelly . . . . la douz. **12** »




Fig. 40

61 **Bougie** conique olivaire et à béquille du professeur Guyon (fig. 40) . la douz. **15** »



Fig. 41

62 **Bougie** cylindrique à béquille de Mercier (fig. 41) . . . . la douz. **12** »

63 **Bougie** cylindrique bicoudée de Mercier. **15** »



Fig. 42

64 **Bougie** conique olivaire à renflement, dite à ventre, de Ducamp (fig. 42). la douz. **18** »

65 **Bougie** conique à ventre. . . . . **18** »

66 **Bougie** en cire blanche ou jaune . . . . la douz. **6** »

67 **Bougie** cylindro-conique porte-empreinte de Ducamp . . . . **24** »

68 **Bougie** porte-empreinte, graduée de centimètre en centimètre . . . . la douz. **30** »

On pourra avoir recours à ces deux derniers instruments pour constater la présence de corps étrangers dans l'urèthre.

69 **Bougie** conique olivaire, intérieur tige en baleine du Dr Gaudmont . . la douz. **18** »

70 **Bougie** conique olivaire du Dr Langlebert, avec mandrin dilatateur en baleine (fig. 43) . . . . la pièce **4 50**



Fig. 43

L'auteur introduit d'abord une bougie à rainure formant gaîne, correspondant au calibre des rétrécissements, glisse ensuite le mandrin dans cette bougie et arrive ainsi à dilater les rétrécissements instantanément et par distension, de deux à quatre millimètres.

71 **Bougie** à bout filiforme olivaire de Legouest, dite à fouet (fig. 44). . . la douz. **24** »




Fig. 44

72 **Bougie** ci-dessus raccordée en deux pièces. . . . . la douz. **42** »

73 — à bout filiforme, de Legouest, en tissu de soie . . . . la douz. **36** »

74 **Bougie** à cône prolongé, du Dr Lesi, dite en queue de rat. . . . . . la douz. **24** »

75 **Bougie** pour la dilatation extemporanée, du Dr Hamonic, nos 1 et 2 (fig. 45) . . . . la pièce **4 50**

Le dilatateur no 1 correspond à son extrémité terminale au n° 2 de la filière et à sa base, extrémité opposée, au n° 15; le n° 2 correspond à son extrémité terminale au n° 4 de la filière pour finir par le n° 24, 8 millimètres à son extrémité opposée. La longueur totale est de 75 cent.

Le Dr Hamonic emploie ces dilatateurs, qui sont à cône infiniment prolongé, pour faire la dilatation lente, progressive et extemporanée, passant d'abord le n° 1; ensuite le n° 2; l'auteur dit arriver à faire une bonne dilatation en deux ou en trois séances.

76 **Dilatateur** ci-dessus raccordé en deux pièces . . . . chaque **6** »

Tous nos instruments dénommés aux nos 71 à 78 sont d'une grande souplesse, ce qui permet à leur extrémité filiforme de s'enrouler dans la vessie sans aucun inconvénient.

77 **Bougie** filiforme olivaire de 6 grosseurs différentes, n° 3 au n° 9, la pièce **4** »

78 **Bougie** filiforme conductrice double de longueur, du Dr Philips . . . . la douz. **30** »



Fig. 46

79 **Bougie** conique olivaire en baleine, du Dr Reliquet (fig. 46) . . . . . la douz. **15** »

80 **Bougie** olivaire en baleine, nos 1 à 6 (fig. 44) . . . . la douz. **12** »

81 **Bougie** conique olivaire à ressort métallique interne, modèle Gaillard, nos 4 à 12. . . . . la douz. **18** »



Fig. 45

Fig. 47

82 **Bougie** conique olivaire à intérieur fil métallique du Dr Bazy, modèle Gaillard, nos 2 à 6 . . . . la douz. **18** »

L'extrémité olivaire de cette bougie, prenant toutes les formes, est complètement inoffensive.




Fig. 48

83 **Bougie** conique olivaire à intérieur crin de Florence, modèle Gaillard, nos 1 à 9 (fig. 48) (voir note, page 6) . . . . la douz. **18 »**

84 **Bougie** conductrice pour la sonde de Pezzer, cathétérisme rétrograde, modèle Gaillard (fig. 49). **3 50**

Fig. 49

Bougies filiformes spéciales

Tissées en soie pour être montées, pour Béniqué ou Uréthrotomie



Fig. 50

85 **Bougie** filiforme à bout olivaire (fig. 50) . . . . **12 »**



Fig. 51

86 **Bougie** filiforme à bout conique (fig. 51) . . . . la douz. **12 »**



Fig. 52

87 **Bougie** filiforme cylindrique (fig. 52) . . . . la douz. **10 50**
Toutes nos bougies filiformes sont fortement soutenues et renforcées à la base, elles ne peuvent pas casser à l'usage de conducteurs pour béniqué ou d'uréthrotomes, elles s'enroulent facilement dans la vessie.



Fig. 53

88 **Bougie** filiforme olivaire armée pour conducteur de béniqué, cathéter du Professeur Guyon (fig. 53) . . . . la douz. **24 »**

89 **Bougie** conductrice pour le cathéter du Dr Lefort . . . . la douz. **36 »**

Bougies, Cathéters et sondes métalliques

Fig. 54

90	**Bougie** cathéter, en métal nickelé, du Professeur Guyon (fig. 5 4)	3 50
91	**Bougie** cathéter, en métal nickelé, du Professeur Albarran	4 »
92	**Bougie** cathéter du Dr Bazy	4 »
93	**Bougie** en étain de Béniqué	1 50
94	**Bougie** cathéter du Dr Lefort, 3 numéros à	5 »
95	Série de 21 cathéters du Professeur Guyon (fig. 54), nos 24 à 44, en boîte noyer découpé, avec 6 bougies conductrices (fig. 53)	125 »
96	Série de 21 cathéters, en boîte métal nickelé, avec 6 bougies conductrices	160 »
97	Série complète de 37 cathéters, nos 24 à 60, en boîte noyer découpé, avec 12b ougies conductrices	200 »
98	Série complète de cathéters en boîte métal nickelé, avec 12 bougies conductrices	250 »
99	**Boîte en chêne** ou noyer pour bougie en étain de Béniqué, prix variant suivant la série de bougies 30 à	50 »
100	**Sondes en métal** diverses	
101	**Bougie** en cire blanche ou jaune . . . la douz.	6 »
	— en boyau de forme cylindrique nos 1 à 9 . . . la douz.	5 »
	— en boyau de forme cylindrique 10 à 15 . . . —	8 »
	— en boyau de forme cylindrique 16 à 20 . . . —	12 »
102	**Tiges** en lamimaria pleines, long. 7 c/m, assorties	7 50
103	— — creuses, long. 7 c/m, assorties . . . la douz.	10 »
104	— — assorties longues, nos 21 à 27 . . . la douz.	12 »

Uréthrotomie interne

Fig. 55

105	**Bougie** conductrice armée pour uréthrotome (fig. 55) . . . la douz.	24 »
106	**Uréthrotome** à 3 lames de Maisonneuve, 4 bougies conductrices	22 »

107 **Uréthrotome** du Professeur of Albarran 6 bougies conductrices . . . . **28** »



Fig. 56

108 **Sonde** percée du bout, un ou deux yeux latéraux, du Professeur Guyon (fig. 56) . . . . la douz. **15** »




Fig. 57

109 **Sonde** percée du bout de Maisonneuve, par glissement avec conducteurs (fig. 57). **4** »

110 **Sonde** percée du bout de Maisonneuve . . . . la douz. **12** »




Fig. 58

111 **Sonde** cylindro-conique percée du bout, un ou deux yeux latéraux, des Drs Morau Wolf et Jamin (fig. 58) . . . . la douz. **15** »



Fig. 59

112 **Sonde** percée du bout, un ou deux yeux latéraux, en tissu de soie, du Professeur Guyon, modèle Gaillard (fig. 59) . . . . la douz. **18** »
D'une souplesse extrême, égale à celle des sondes Nélaton, son très grand diamètre intérieur a la surface gommée et polie, aussi lisse qu'à l'extérieur et parfaitement aseptique; cette dernière sonde est particulièrement indiquée, pour laisser à demeure après l'uréthrotomie interne, par MM. les Professeurs Guyon et Albarran.

Rétention d'urine

Sondes uréthrales en général aseptiques et stérilisables, à bout plein, gommées à l'intérieur, aussi lisses qu'à l'extérieur (Voir aussi Sondes en tissu de soie).

La figure 60 ci-dessous représente la coupe de l'extrémité de nos sondes en démontrant le bout plein aseptique, le cul-de-sac supprimé, et le gommage de la surface intérieure.



Fig. 60

113 **Sonde** conique olivaire du Dr Guillon (fig. 60). . . . . la douz. **15** »




Fig. 61

114 **Sonde** conique (fig. 61) . . . . la douz. **12** »



Fig. 62

115 **Sonde** droite cylindrique, un ou deux œils tissés (fig. 62). . . . . . . la douz. **9** »




Fig. 63

116 **Sonde** coudée à béquille du Dr Mercier (fig. 63). . . . . la douz. **15** »



Fig. 64

117 **Sonde** olivaire à œil terminal, modèle Gaillard (fig. 64) . . . . . . la douz. **16 50**



Fig. 65

118 **Sonde** cylindrique à extrémité très souple, modèle Gaillard (fig. 65) . la douz. **12** »



Fig. 66

119 **Sonde** conique olivaire, à extrémité très souple, modèle Gaillard (fig. 64). la douz. **18** »

(Voir aussi Sondes en tissus de soie.)

Sondes filiformes tissées en soie spéciale

Du n° 3 au n° 8



Fig. 67

120	**Sonde** conique olivaire filiforme en soie (fig. 67).	la douz.	15 »
121	**Sonde** à béquille de Mercier filiforme en soie	la douz.	15 »
122	**Sonde** conique filiforme en soie	la douz.	15 »



Fig. 68

123	**Sonde** cylindrique filiforme (fig. 68)	la douz.	12 »

Hypertrophie de la Prostate

Sondes diverses pour prostatiques (Voir aussi Sondes en tissu de soie).

124	**Sondes** coudées à béquille de Mercier (fig. 63)	la douz.	15 »

Cette figure représente la coupe de sondes à coudures différentes et graduées. Il suffit d'indiquer la coudure 1, 2, 3, 4, 5, série de sondes à béquille, modèle exclusif de notre maison. Le fragment n°1 est coudé à 25 degrés, le n° 2 à 30, le n° 3 à 35, le n° 4 à 40, le n° 5 à 45.

A ceux de nos clients qui ne trouveraient pas dans cette série la forme de sonde béquille qui leur convient, nous pouvons livrer des sondes avec le bec ou plus court, ou plus allongé; il suffira, pour cela, de nous donner des indications précises.

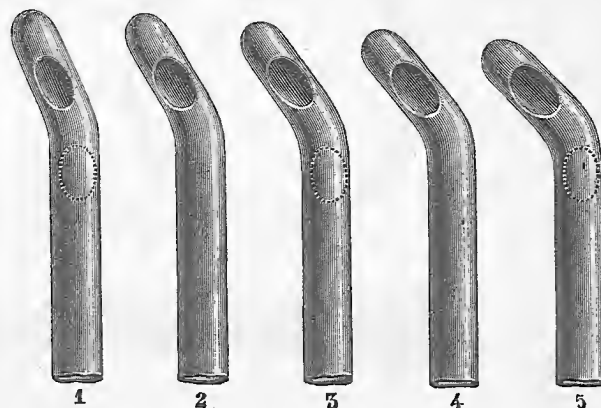


Fig. 69




Fig. 70

125 **Sonde** à béquille, à petite coudure, de Reliquet (fig. 70). . . . . la douz. **15** »



Fig. 71

126 **Sonde** à béquille, à portion prostatique très souple, modèle Gaillard (fig. 71). douz. **18** »



Fig. 72

127 **Sonde** coudée à béquille, œil dans la concavité, modèle Gaillard (fig. 72). . . . . . la douz. **15** »

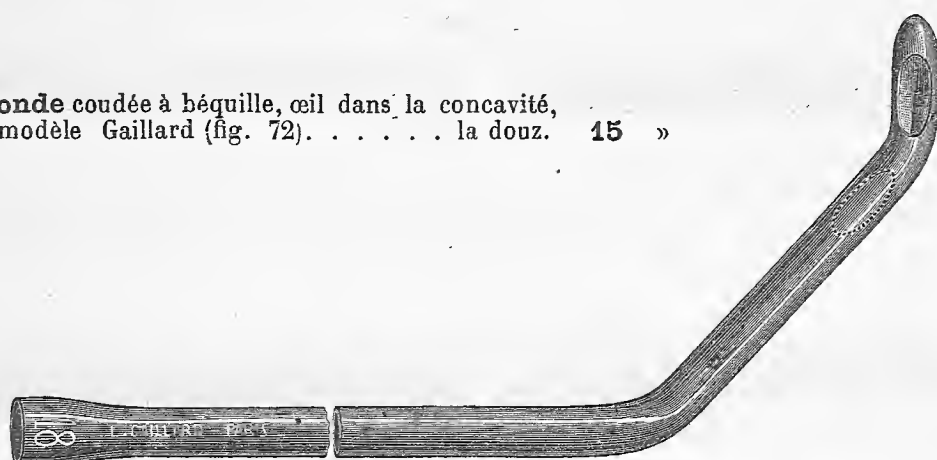


Fig. 73

128 **Sonde** bicoudée de Mercier (fig. 73). . . . . . la douz. **18** »

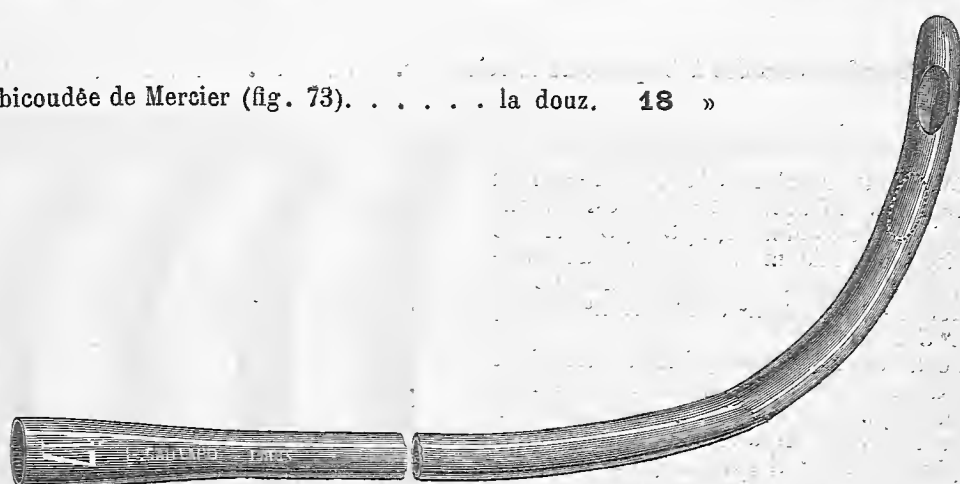


Fig. 74

129 **Sonde** cylindrique à courbure fixe de Gelly (fig. 74). . . . . la douz. **15** »

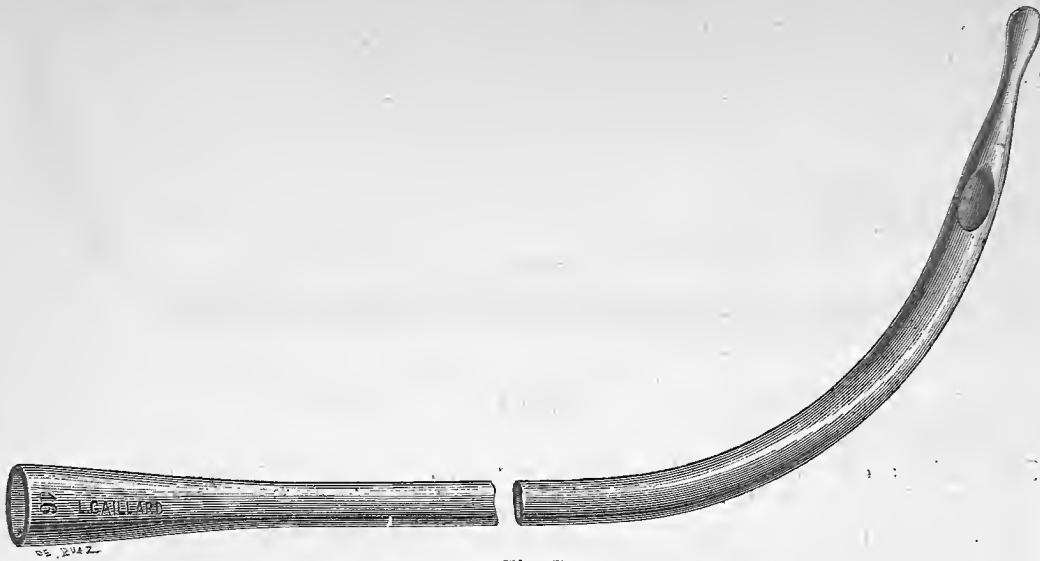


Fig. 75

130 **Sonde** courbe olivaire, à courbure rigide, modèle Gaillard (fig. 75) . . la douz. **18** »
131 **Sonde** conique olivaire courbe (fig. 75) . . . . . la douz. **18** »




Fig. 76

132 **Sonde** conique olivaire et à béquille du professeur Guyon (fig. 76) . . . . la douz. **18** »

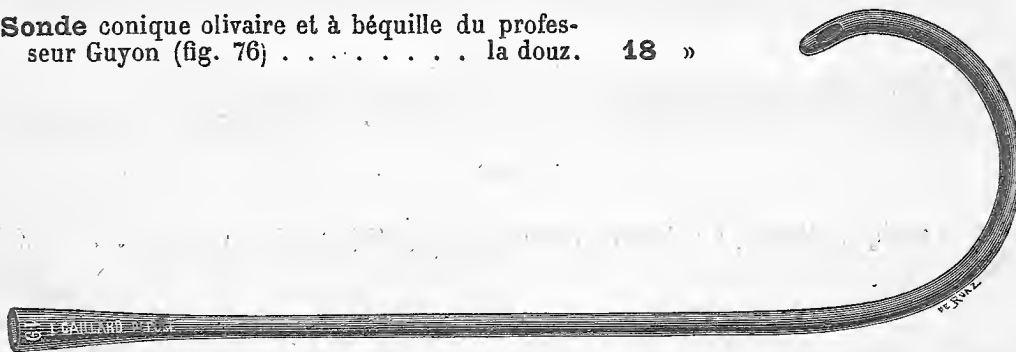


Fig. 77

133 **Sonde** à grande courbure et à béquille, de Reliquet (fig. 77) . . . la douz. **18** »

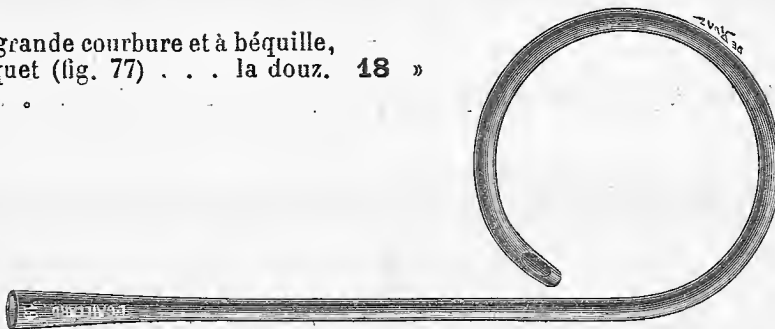


Fig. 78

134 **Sonde** à courbure forcée, pour grosse prostate, du Dr Phélip, modèle Gaillard (fig. 78). (Pourra aussi être utilisée pour laisser fixe à demeure) . . la douz. **30** »
135 **Sondes** pour grosse prostate, du Dr Phélip, 3 coudures, modèle Gaillard, la douz. **30** »
136 **Sonde** à béquille et à talon (pour appuyer le bec contre la paroi supérieure de l'urèthre) . . . . la douz. **18** »

Par un procédé spécial de fabrication, nous obtenons des sondes (fig. 73, 74 et 75, et des bougies fig. 39, nos 59, 60 et 61) dont la courbure ne se modifie pas pendant le cathétérisme.

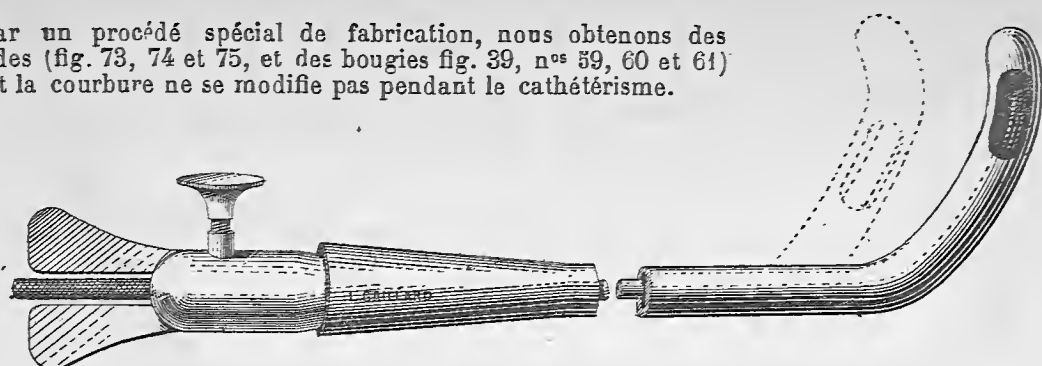


Fig. 79

137 **Mandrin** à cône et écrou, du professeur Guyon, pour modifier la courbure des sondes pendant le cathétérisme (fig. 79). **3 50**

138 **Mandrin** du professeur Guyon, la courbure en forme de béniqué. **3 50**

Sondes et Bougies noires à portion prostatique blonde très souple



Fig. 80

139 **Sonde** droite cylindrique, à extrémité souple (fig. 80), modèle Gaillard, la douz. **12** »



Fig 81

140 **Sonde** conique olivaire, à extrémité très souple (fig. 81), modèle Gaillard . . . **18** »




Fig. 82

141 **Sonde** à béquille, à portion prostatique souple (fig. 82), modèle Gaillard . . . . **18** »



Fig. 83

142 **Bougie** conique olivaire, à extrémité souple (fig. 83), modèle Gaillard . . . . . **15** »

Par leur portion antérieure très souple, ces sondes offrent des avantages très appréciés en général; l'extrémité est toujours inoffensive par sa souplesse. Elles pénètrent plus facilement dans la généralité des cas, mais elles sont surtout indiquées plus spécialement chez les prostatiques; dans les cas de grosse hyperthrophie de la prostate, leur portion très souple franchira plus facilement cet obstacle, en simulant les courbures différentes qui lui seront imprimées par la légère pression, nécessaire au cathétérisme en pareil cas, et faite sur la partie postérieure de l'instrument.

Sondes à œil moulé en caoutchouc médical pur du Dr Nélaton

(Prière d'indiquer le bout rond, demi-rond, ou pointu)

143 **Sonde** en caoutchouc vulcanisé du Dr Nélaton. La douz. **6** »

144 **Sonde** en caoutchouc vulcanisé, longueur 40 centimètres . . . . la douz. **10** »



Fig. 84

145 **Sonde** en caoutchouc vulcanisé, bout plein aseptique, du Dr Nélaton, modèle des Hôpitaux (fig. 84) . . . . la douz. **9** »

146 **Sonde** en caoutchouc vulcanisé, bout plein, 40 centimètres (fig. 84). . la douz. **12** »




Fig. 85

147 **Sonde** en caoutchouc vulcanisé, à entonnoir, des Drs Guyon et Nélaton, modèle des Hôpitaux (fig. 85). . . . . la douz. **12** »

La figure ci-dessus représente la coupe de nos sondes Nélaton, à bout plein aseptique.

147 *b* **Sonde** Nélaton à entonnoir, longueur 40 c/m. . . . . la douz. **15** »

148 **Sonde** vulcanisée de Nélaton, aseptique. . . . . la douz. **7 50**

149 **Sonde** en caoutchouc vulcanisé, à béquille . . . . la douz. **15** »

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour les sondes Nélaton, du no 7 à 23.

150 **Sondes** Nélaton en général, du no 24 à 30 . . . . en plus, par douz. **6** »

151 **Sonde** en caoutchouc, pour lavages blennorrhagiques . . . . la douz. **12** »

Sondes et Bougies en tissu de soie spéciale (très souples), modèle Gaillard

Que nous fournissons dans les Hôpitaux de Paris.



Fig. 86

152 **Sonde** cylindrique, souple en soie (fig. 86) . . . . la douz. **15** »



Fig. 87

153 **Sonde** conique olivaire, souple en soie (fig. 87) . . . . la douz. 21 »



Fig. 88

154 **Sonde** conique olivaire en soie, à œil terminal, modèle Gaillard (fig. 88), la douz. 21 »




Fig. 89

155 **Sonde** coudée à béquille de Mercier, souple en soie (fig. 89) . . . . . la douz. 21 »



Fig. 90

156 **Sonde** percée du bout, souple, en soie, à un ou deux œils latéraux, du professeur Guyon (fig. 90) . . . . la douz. 21 »



Fig. 91

157 **Sonde** percée du bout, cylindro-conique en soie, modèle Gaillard (fig. 91), la douz. 21 »



Fig. 92

158 **Sonde** irrigatrice en soie, du Professeur J. Albarran, modèle Gaillard (fig. 92), à œillets tissés, pour irrigations dans l'urèthre postérieur, traitement de l'uréthrite chronique . . . . la douz. 30 »



Fig. 93

159 **Bougie** conique olivaire du Dr Guillon, très souple, en tissu de soie (fig. 93), la douz. 18 »

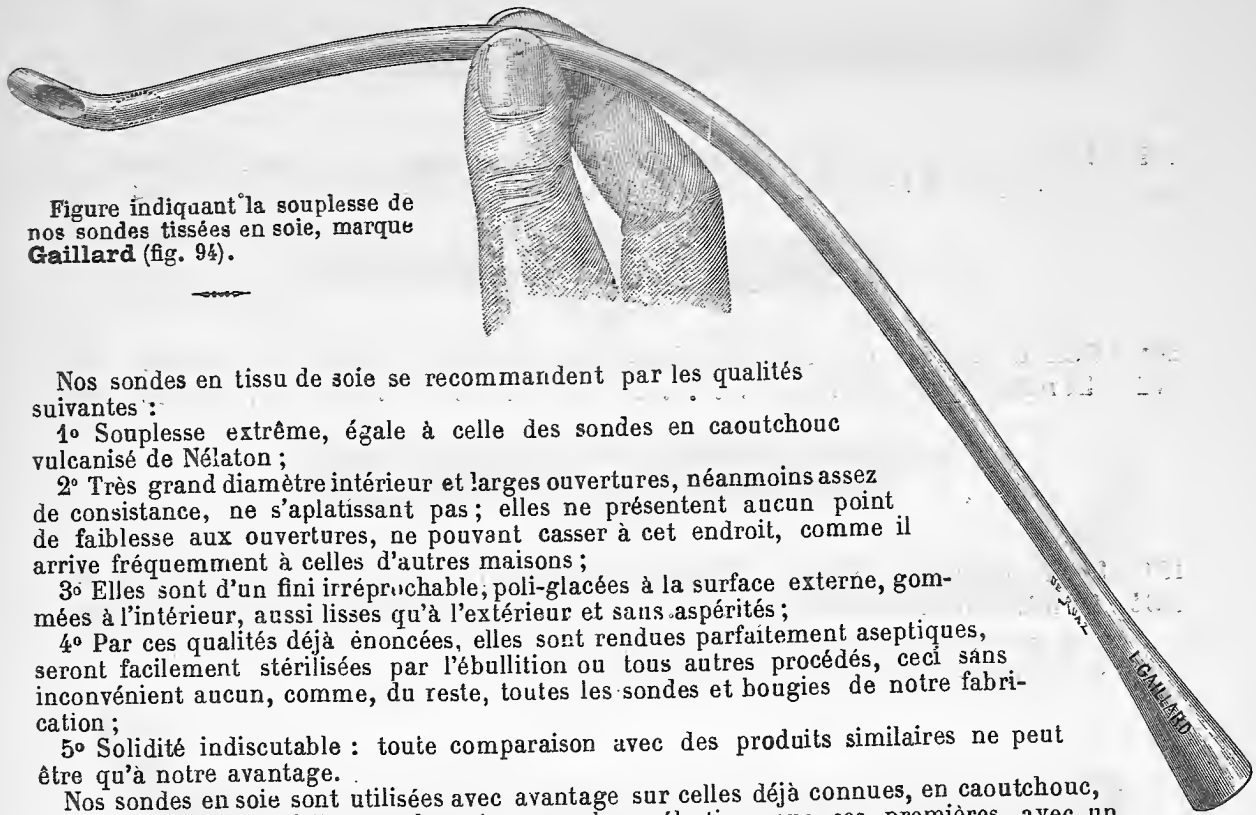


Figure indiquant la souplesse de nos sondes tissées en soie, marque **Gaillard** (fig. 94).

Nos sondes en tissu de soie se recommandent par les qualités suivantes :

1° Souplesse extrême, égale à celle des sondes en caoutchouc vulcanisé de Nélaton ;

2° Très grand diamètre intérieur et larges ouvertures, néanmoins assez de consistance, ne s'aplatissant pas ; elles ne présentent aucun point de faiblesse aux ouvertures, ne pouvant casser à cet endroit, comme il arrive fréquemment à celles d'autres maisons ;

3° Elles sont d'un fini irréprochable, poli-glacées à la surface externe, gommées à l'intérieur, aussi lisses qu'à l'extérieur et sans aspérités ;

4° Par ces qualités déjà énoncées, elles sont rendues parfaitement aseptiques, seront facilement stérilisées par l'ébullition ou tous autres procédés, ceci sans inconvénient aucun, comme, du reste, toutes les sondes et bougies de notre fabrication ;

5° Solidité indiscutable : toute comparaison avec des produits similaires ne peut être qu'à notre avantage.

Nos sondes en soie sont utilisées avec avantage sur celles déjà connues, en caoutchouc, ou autres, parce qu'elles ont la même souplesse élastique que ces premières, avec un diamètre intérieur beaucoup plus large, avec plus de force de pénétration; de là une plus grande facilité pour le cathétérisme.

La sonde percée du bout, en soie, est particulièrement indiquée pour laisser à demeure après l'uréthrotomie interne; sa souplesse fait qu'elle est mieux supportée par un urèthre nouvellement incisé. — La sonde à béquille en soie, par ces mêmes qualités, convient particulièrement aux urèthres prostatiques friables ; avec une sonde de calibre restreint, on pourra faire, s'il y a lieu, des lavages abondants et précipités ; de même, les urines chargées, purulentes, ou encore lorsqu'il subsistera des caillots ou des graviers, la vessie sera plus facilement et rapidement évacuée. (Voir aussi notre série de sondes coudées d'après les prescriptions du Profr Guyon, page 15).

La bougie en tissu de soie : à la grande souplesse de cet instrument, est unie une certaine fermeté ; ses qualités propres la désignent de préférence à tout autre instrument ; elle convient particulièrement pour la dilatation des urèthres sensibles, facilement irritables, ou encore pour maintenir à un calibre respectable, normal, un canal uréthrotomisé.

En résumé, nous présentons ici à nos clients des instruments fabriqués dans de telles conditions, qu'ils sont complètement inoffensifs et peuvent, sans inconvénient, être confiés en des mains inhabiles ou inexpérimentées.

Notre maître, M. le Profr Guyon, conseille de pratiquer l'aspiration des graviers, après la lythotritie, ou des caillots, avec une simple seringue vésicale, et à l'aide d'une sonde en tissu de soie ; cet arsenal très simple offre toute garantie de succès, pourvu qu'il soit construit dans de bonnes conditions.

Sondes spéciales diverses



Fig. 95

160 **Sonde** à béquille, à six œils latéraux, du Dr Bazy (fig. 95) . . . . . . la douz. **24** »




Fig. 96

161 **Sonde** à béquille, à œils multiples groupés, nouveau modèle que nous construisons pour le Dr P. Bazy, en tissu de soie, modèle Gaillard (fig. 96) . . la douz. 30 »



Fig. 97

162 **Sonde** olivaire, à œils multiples, du Dr Bazy, en tissu de soie (fig. 97) . la douz. 30 »
162 *b* La même, qualité ordinaire. . . . . la douz. 24 »



Fig. 98

163 **Sonde** cylindrique, à œils multiples, en soie (fig. 98). . . . . la douz 24 »
163 *b* La même, qualité ordinaire . . . . la douz. 18 »

M. le Dr Bazy emploie ces sondes chez les malades atteints de catarrhe vésical, et pour pratiquer des lavages ou irrigations rapides.




Fig. 99

164 **Sonde** à béquille, à large ouverture évacuatrice, modèle Gaillard (fig. 99), la douz. 30 »

Pour l'évacuation des calculs ou débris de pierres après la lithotritie, nous faisons ces sondes du n° 20 et au-dessus.



Fig. 100

165 **Sonde** à boule perforée, du professeur Guyon (fig. 100). . . . . la douz. 15 »
166 **Sonde** conique à grosse olive, du Dr Delaissement . . . . la douz. 18 »



Fig. 101

167 **Sonde** à prolongement, bout filiforme olivaire, de Philips ou Legouest, la douz. 30 »
168 Cette même sonde, en tissu de soie (fig. 101). . . . . la douz. 36 »



Fig. 102

169 **Sonde** de Philips, avec bougie filiforme raccordée (fig. 102). . . . . . la douz. 48 »
170 **Sonde** conique et olivaire à renflement, dite à ventre . . . . la douz. 18 »

On peut faire usage de cette sonde pour vider la vessie, chez un malade atteint de rétrécissement dans la portion pénienne de l'urèthre; dans ce cas, le renflement de cette sonde sert de dilatateur, laissant ainsi au repos la partie saine du canal uréthral.



Fig. 103

171 **Sonde** à béquille à raccord métallique pour trousse (fig. 103) . . . . . chaque **3 50**
172 **Sonde** olivaire pour trousse . . . . chaque **3 50**
173 **Sonde** cylindrique pour trousse . . . . chaque **3 »**

Ce même dispositif peut aussi être employé pour les bougies uréthrales ou sondes œsophagiennes.

Sondes spéciales pour laisser à demeure




Fig. 104

174 **Sonde** coudée à béquille, tissée en soie, modèle Gaillard (fig. 104). . . la douz. **21 »**



Fig. 105

175 **Sonde** percée du bout, tissée en soie, du professeur Guyon (fig. 105) . la douz. **21 »**




Fig. 106

176 **Sonde** à demeure du Dr de Pezzer (fig. 106), net. la pièce **2 75**, la douz. **30 »**
177 **Sonde** pour placer à demeure, à portion renforcée, d'après le Profr Guyon, la pièce **3 50**
178 **Sonde** à demeure, système du Dr Malécot (fig. 107) . . . . la pièce **2 50**

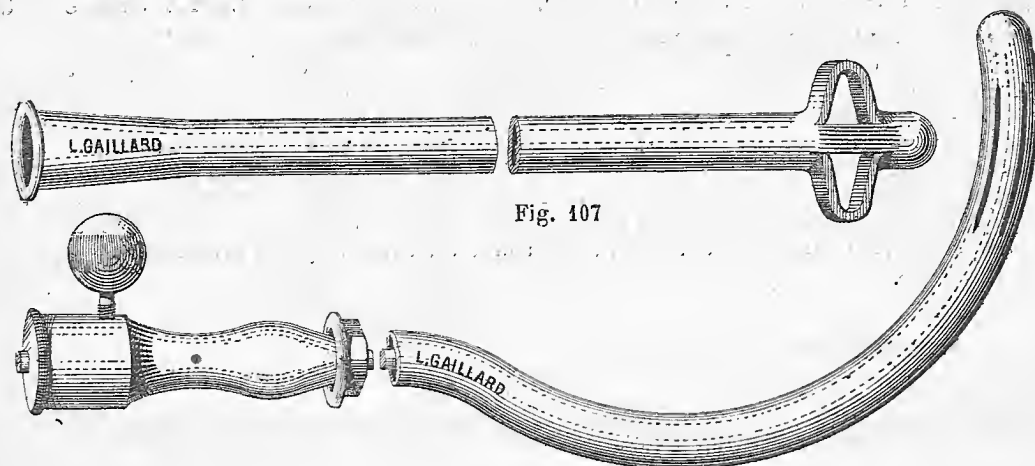


Fig. 107



Fig. 108

179 **Mandrin** en métal nickelé, pour placer les sondes (fig. 108) . . . . . la pièce **3 50**

180 **Mandrin** en baleine, avec presse, tige métal. . . . . la pièce 3 50



Fig. 109

181 **Sonde** à demeure, en caoutchouc vulcanisé, du Dr Desnos, modèle Gaillard, breveté S. G. D. G (fig. 109) . . . . la douz. 24 »

Sur indications spéciales, nous faisons ces sondes en caoutchouc vulcanisé genre Nélaton, et des numéros 16 à 26 une série de six sondes.

Elles se placent à demeure, sans mandrin, avec grande facilité dans la majeure partie des cas, de là aucune crainte d'accident.

Le Dr Desnos emploie exclusivement cette sonde avec succès.

182 **Sonde** à demeure en tissu de soie, nouveau modèle Gaillard . . . . 3 »

Taille hypogastrique, Cystotomie ou Taille suspubienne




Fig. 110

183 **Sonde** à demeure par cathétérisme rétrograde, du Dr de Pezzer (fig. 110) chaque, net. . . . . 2 75 la douz. 30 »

184 **Bougie** en tissu de soie, modèle Gaillard, pour placer à demeure (fig. 111) chaque 3 50

En construisant cette bougie, nous avons été guidé par le désir de mettre entre les mains du chirurgien un instrument simple, offrant en même temps un moyen sûr et pratique pour placer à demeure la sonde (fig. 110) ; pour ce faire, le praticien pourra procéder ainsi ; l'incision terminée, introduire par le col de la vessie la partie à olive simple de notre bougie conducteur, continuer le cathétérisme d'arrière en avant : ce premier temps terminé, retirer la bougie en la saisissant par l'extrémité côté du méat, ceci après avoir introduit la première olive dans la sonde, si possible jusqu'à la base de la deuxième olive, disposée de façon à empêcher le frottement du rebord de la sonde à travers la paroi uréthrale.

Fig. 111




Fig. 112

185 **Tube** en caoutchouc pur, pour rallonge de sondes (fig. 112) . . . . la douz. 15 »




Fig. 113

186 **Ballons** de Petersen, de 200 à 700 grammes (fig. 113). . . . . 7 »



Fig. 114

187 **Tube** à double courant, des Drs Perrier et Guyon, pour drainage de la vessie (fig. 114) 6 »
188 **Sonde** à béquille, à ampoule, du Profr Guyon . . . . 4 »

Appareils pour fistule ou méat hypogastrique (modèle Gaillard).



Fig. 115

189 **Bouton** canalisateur en caoutchouc durci, du Dr Drouin, modèle Gaillard (fig. 115) . . . . la douz. 15 »

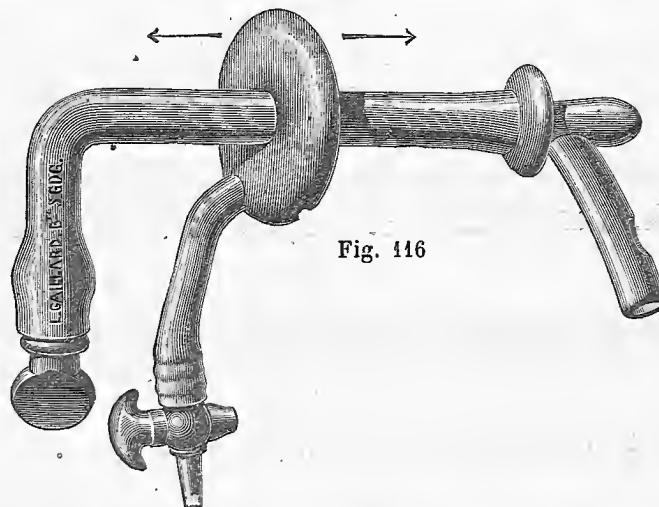


Fig. 116

190 **Appareil** contenteur et régulateur de la mixtion urinaire, du Dr Quinto Vignolo, modèle Gaillard (fig. 116), l'appareil complet. . . . . 10 »
Pour méat artificiel après la cystostomie suspubienne que nous faisons de 5, 6, 7 et 8 centim. de longueur.



Fig. 117

191 **Tube** en argent, longueur proportionnée à celle de l'appareil, pour, si besoin est, donner plus de consistance aux parois de ce dernier (fig. 117). Prix. 2 50 à 4 »



Fig. 118

192 **Mandrin** pour la mise en place de notre urinal hypogastrique (fig. 116) . . . 3 50
La figure 118 représente notre appareil au moment de l'introduction.

Uréthrotomie externe, Taille périnéale

193 **Sonde** cylindrique à bout filiforme à l'autre extrémité. . . . . 4 »
194 **Sonde** conique olivaire et filiforme à l'autre extrémité 4 50



Fig. 119

195 **Sonde** à béquille avec filiforme à l'autre extrémité (fig. 119) 4 50

Blennorrhagie, Instillations caustiques et Lavages blennorrhagiques



Fig. 120

196 **Instillateur** à boule perforée, du Profr Guyon (fig. 120). . . . . . la douz. 15 »



Fig. 121

197 **Instillateur** en pomme d'arrosoir, du Profr Albarran, modèle Gaillard, breveté S. G. D. G., en tissu de soie (fig. 121) . . . . 30 »

Sur les indications du Profr Albarran, nous construisons cette sonde en tissu de soie et les œillets tressés dans le tissu, qualités indispensables à son bon fonctionnement et aussi à sa solidité. Nous prions donc MM. nos clients de se méfier des instruments présentant à peu près le même aspect, offerts sous une autre dénomination, par des confrères n'ayant que le souci de faire bon marché, se souciant peu de la qualité de leurs produits. — (Voir aussi sonde irrigatrice en tissu de soie.)



Fig. 122

198 **Instillateur** à béquille, du Dr Tuffier (fig. 122) . . . . la douz. **18** »



Fig. 123

199 **Sonde** à deux boules, à jet récurrent, du Dr Tuffier, modèle Gaillard (fig. 123). . . . . la douz. **21** »



Fig. 124

200 **Sonde** à deux boules, pour localiser l'instillation du Dr Tuffier, modèle Gaillard (fig. 124). . . . . la douz. **21** »



Fig. 125

201 **Sonde** à boule, à jet récurrent, de Thèvens (fig. 125) . . . . la douz. **18** »



Fig. 126

202 **Sonde** à boule simple (fig. 126) . . . . la douz. **15** »



Fig. 127

203 **Instillateur** vésical du Dr Janet, modèle Gaillard (fig. 127) . . . . . la douz. **15** »
A l'usage des malades, pour faire les instillations dans la vessie à l'aide de leur sonde usuelle.




Fig. 128

204 **Instillateur** à olive excentrique, du Profr Guyon, sans conducteur (fig. 128). la douz. **18** »



Fig. 129

205 **Instillateur** à boule conduit, du Dr Phélip, modèle Gaillard (fig. 129), la douz. **24** »
A conducteur filiforme de 10 c/m et 18 centimètres.



Fig. 130

206 **Sonde** filiforme à boule et deux œillets, du Dr Lagoudaky, modèle Gaillard (fig. 130). . . . . la douz. **18** »



Fig. 131

207 **Instillateur** à boule lancéolée, du Dr Hamonic, modèle Gaillard (fig. 131) la douz. **30** »



Fig. 132

208 **Sonde** à béquille, à œillets multiples, du Dr Desnos, pour instillation derrière la prostate, modèle Gaillard (fig. 132). . . . . la douz. **18** »

209 **Sonde** à olive cannelée, pour instillation, du Dr Lavaud, modèle Gaillard, la douz. **24** »

210 **Instillateur** à boule ovalaire, de Pouchet. . . . . la douz. **15** »



Fig. 133

211 **Sonde** à boule drainée, à œils multiples, du Dr E. Desnos (fig. 133) . . la douz. **24** »



Fig. 134

212 **Sonde** en tissu de soie, à boule drainée, œillets multiples, du Dr Desnos, modèle Gaillard (fig. 134). . . . . la douz. **24** »
Pour le bon fonctionnement de cette sonde, nous avons dû réduire les œillets à leur plus simple expression, comme l'indique la figure 132, et la construire en tissu de soie très fine.



Fig. 135

213 **Sonde** drainée du Dr Desnos, à œillets multiples, pour lavages de l'urèthre, modèle Gaillard, en tissu de soie (fig. 135) . . . . la douz. **15** »

214 La même à deux œils, en tissu de soie, du Dr H. Barnsby, modèle Gaillard, ... la douz. **15** »

215 **Sondes** droites cylindriques à un seul œil, pour lavages blennorrhagiques, traitement abortif du Dr Boureau, n° 11 de la filière, deux longueurs 15 et 25 centimètres. . . . . la douz. **9** »

216 **Sonde** en caoutchouc vulcanisé, drainée pour lavages de l'urèthre. . . la douz. **15** »

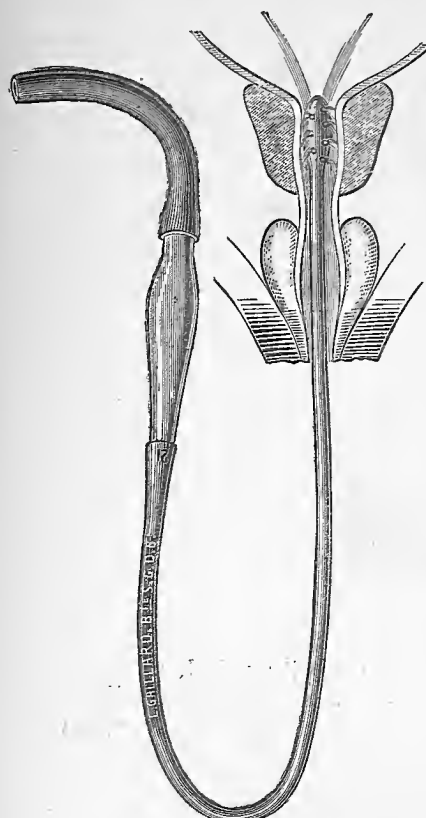


Fig. 136

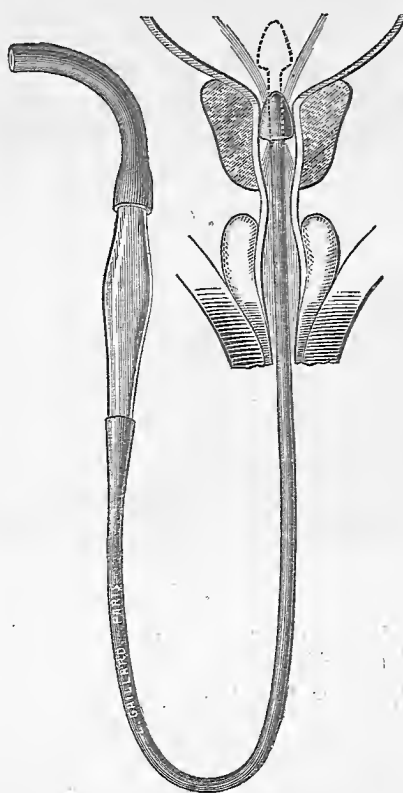


Fig. 137

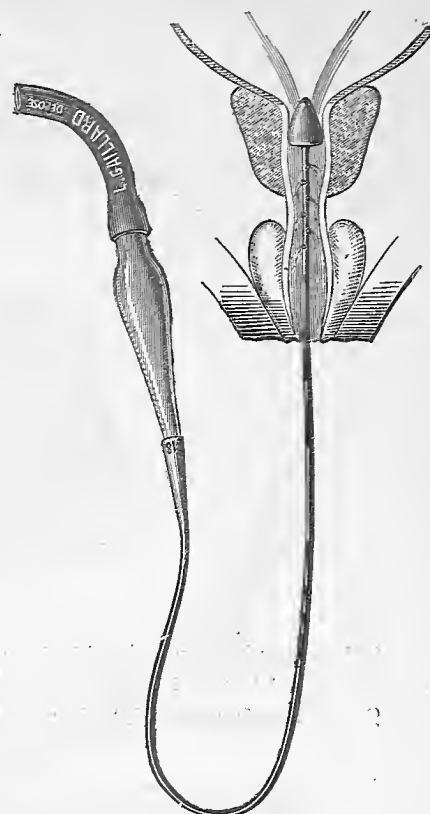


Fig. 138

Figures représentant une coupe de l'urèthre postérieur, les sondes à instillation fonctionnant.

Seringues pour instillations

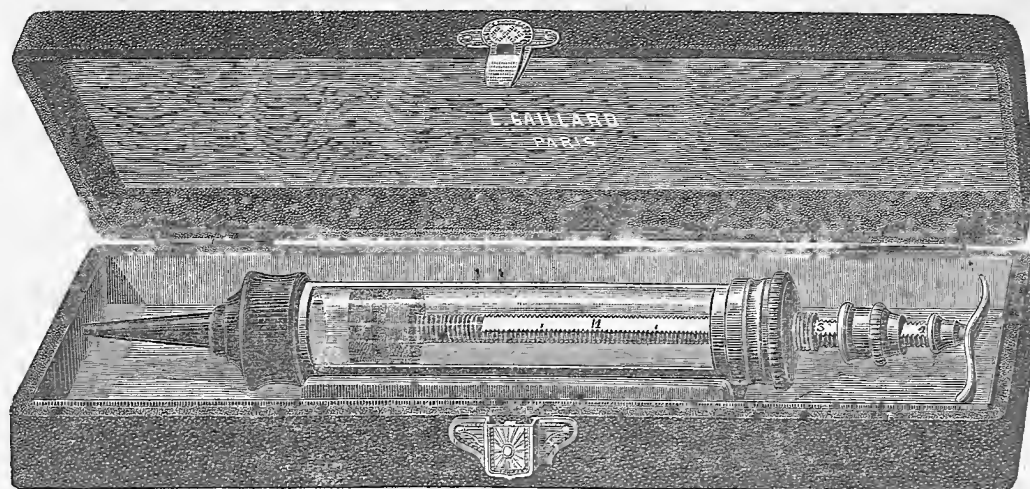


Fig. 139

217 **Seringue** avec sonde à boule pour instillations, de Guyon, mod. Gaillard (fig. 139) **10** »
218 **Seringue** à instillations, en métal nickelé . . . . en boîte **12** »
219 **Seringue** à instillations, en métal nickelé . . . . en boîte **15** »

220 **Seringue** à instillations, du Prof[r] Guyon, en métal nickelé, en boîte, gainerie riche . . . . 18 »




Fig. 140

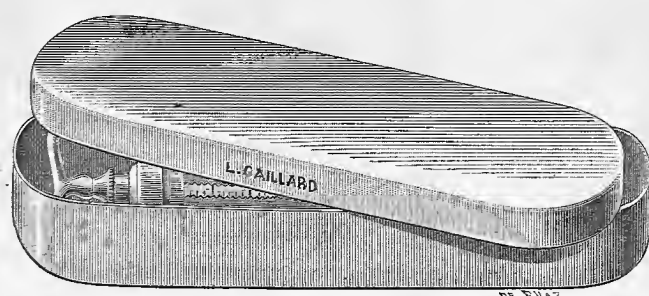


Fig. 141

221 **Seringue** à instillations du Prof[r] Guyon, en argent stérilisable, en boîte métal, nickelé, modèle Gaillard (fig. 140 141) . . . . 25 »

222 **Seringue** à jet récurrent, du D[r] Langlebert. 3 50



Fig. 142

223 **Porte-pommade** en vrille, du D[r] Janet, modèle Gaillard, pour l'urèthre postérieur (fig. 142). . . . . 6 »



Fig. 143

224 **Porte-pommade** du D[r] Janet, modèle Gaillard, pour l'urèthre antérieur (fig. 143) 5 »



Fig. 144

225 **Bougie** porte-tube médicamenteux pour l'urèthre antérieur, du D[r] Janet, modèle Gaillard (fig. 144). . . . . 2 »



Fig. 145

226 **Porte-tube** médicamenteux, pour l'urèthre postérieur, du D[r] Janet, modèle Gaillard (fig. 145). . . . . 4 »

227 **Tubes** médicamenteux du D[r] Janet . . . . la douz. 5 »




Fig. 146

228 **Porte-caustique** du Dr Langlebert, sonde en gomme graduée et tige à boule en baleine, monture métallique (fig. 146). . . . . 8 »

229 **Porte-caustique** simple du Dr Langlebert, sonde et bougie à boule en gomme 4 »

Sondes ou Canules à double courant

en gomme stérilisable et à grand diamètre intérieur

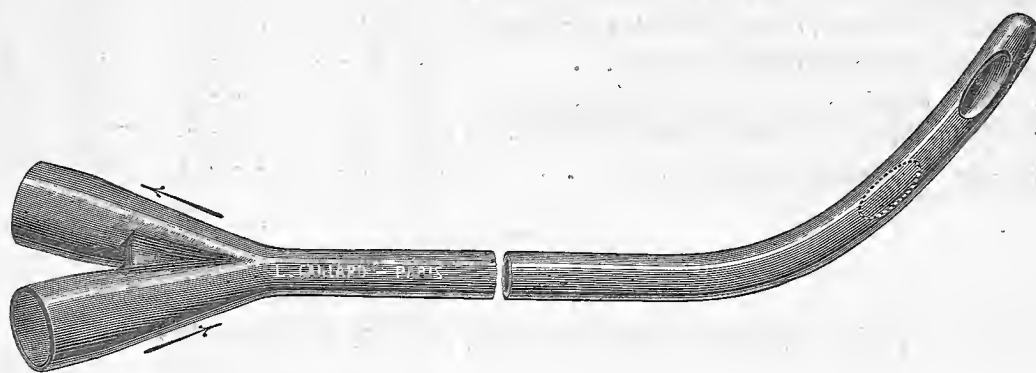


Fig. 147

230 **Sonde** à double courant, pour homme, du Dr Reliquet (fig. 147) . . . la douz. 36 »

231 **Sonde** à double courant du Dr Bazy, nouveau modèle Gaillard . . . . — 36 »

232 **Sonde** à double courant, pour femme . . . . — 30 »

233 **Sonde** olivaire à double courant, pour homme . . . . — 48 »

234 **Sonde** en gomme, à cloison mobile, formant double courant, modèle Gaillard 5 »




Fig. 148

235 **Sonde** à double courant, en tire-bouchon, du Dr Kooc (fig. 148) . . . . la douz. 36 »

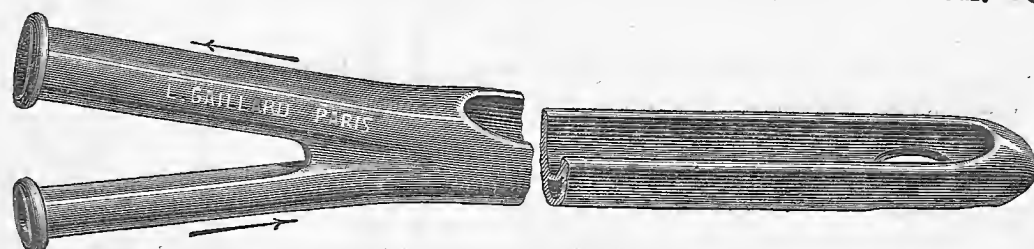


Fig. 149

236 **Sonde** à double courant intra-utérine, du Dr Porak (fig. 149). . . . . . la douz. 48 »

237 **Sonde** à double courant intra-utérine, du Dr Budin, en gomme . . . . 5 »

238 **Sonde** intra-utérine, du Dr Budin, en celluloïde . . . . la pièce 5 »



Fig. 150

239 **Sonde** du Dr Budin, en verre (fig. 150) . . . . la pièce. . 3 »

Sondes métalliques diverses

240	**Sonde** en argent, pour homme	la pièce	5 50
241	**Sonde** en maillechort, pour homme	—	2 50
242	**Sonde** en argent, pour femme	—	3 »
243	**Sonde** en maillechort, pour femme	—	1 50
244	**Sonde** de trousse, en argent, pour homme et femme	—	9 »
245	**Sonde** de trousse, en maillechort, pour homme et femme	—	5 »
246	**Sonde** double courant, en argent	—	9 »
247	**Sonde** double courant, en maillechort	—	4 »
248	**Sonde** à double courant, en métal nickelé, du Dr Doléris	—	15 »
249	**Sonde** intra-utérine du Dr Bozman	—	9 »

Voies urinaires supérieures, Reins, Cystoscopie

Diagnostic et traitement de la Pyonéphrose et autres affections rénales, Cathétérisme des uretères par la voie uréthro-vésicale, méthode du professeur J. Albarran

Voir la *Revue chirurgicale gynécologique*, du Dr Pozzy, juin 1897 ; — la thèse du Dr Imbert, 1898 ; — le tome 8 de *Chirurgie pratique des voies urinaires*, par le Profr J. Albarran, au chapitre *Reins*, 1899 ; — Instruments présentés par l'auteur au Congrès d'Urologie de Moscou 1897, et que, exclusivement, nous construisons en tissu de soie très fine, et d'après les indications du Dr J. Albarran.



Fig. 151

250 **Sonde** urétérale filiforme cylindrique, du Profr Albarran, en tissu de soie, modèle Gaillard (fig. 151). 3 50



Fig. 152

251 **Sonde** urétérale filiforme, percée du bout arrondi, du Profr Albarran, modèle Gaillard (fig. 152). 3 50



Fig. 153

252 **Sonde** urétérale filiforme, bout olivaire, du Profr Albarran, en tissu de soie, modèle Gaillard (fig. 153) 3 50

253 **Sonde** urétérale pour femme, du Profr Albarran, en tissu de soie, modèle Gaillard (fig. 154) 2 50

254 **Sonde** urétérale pour homme, du Profr Albarran, en tissu de soie, modèle Gaillard (fig. 155). . . . . 3 »

Conducteurs pour les sondes urétérales du Prof^r Albarran, modèle Gaillard

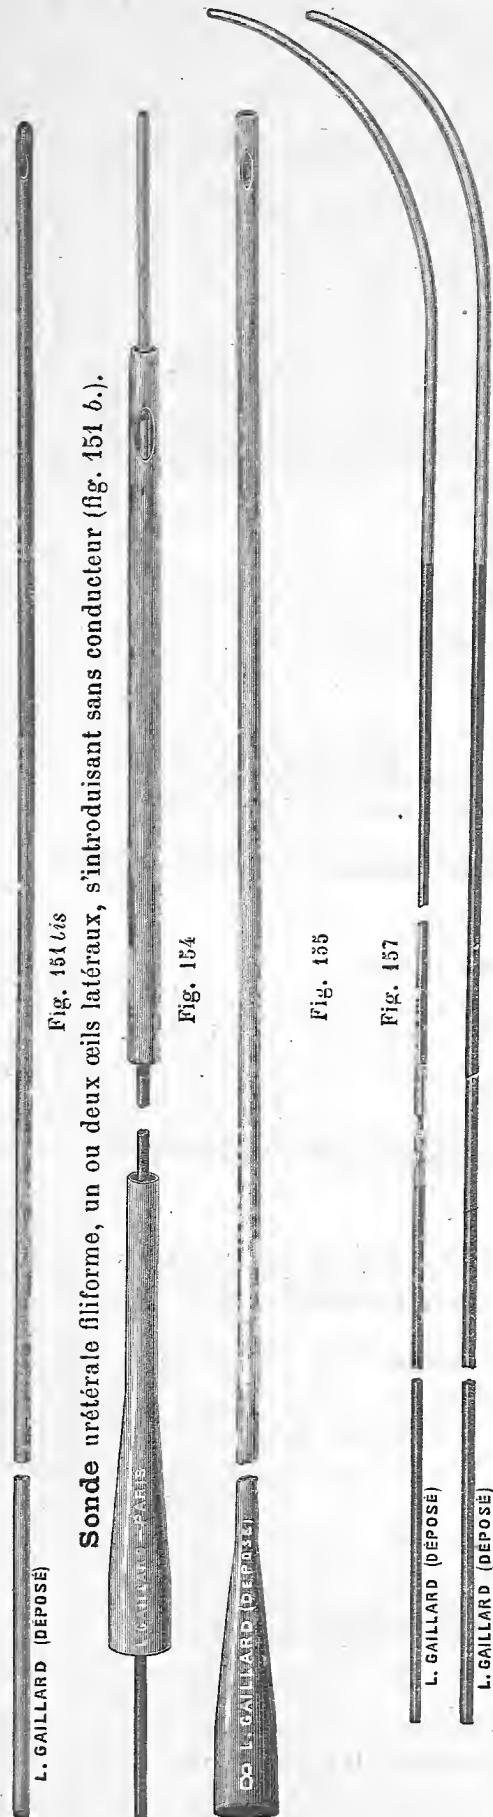


Fig. 151 *bis* Fig. 154 Fig. 155 Fig. 157 Fig. 158

Sonde urétérale filiforme, un ou deux œils latéraux, s'introduisant sans conducteur (fig. 151 *b*).

255 **Conducteur** en baleine, bout flexible, à rallonge avec raccords métalliques, pour sonde d'homme, modèle Gaillard (fig. 157) **7 50**

256 **Conducteur** en baleine, à bout flexible, simple, pour sonde de femme, modèle Gaillard (fig. 158) . . . . **5 »**

La fig. 154 représente une sonde pour femme avec son conducteur, à bout flexible.




Fig. 159

Représentant la série de sondes filiformes, grosseurs nature des n°s 6, 6 1/2, 7, 7 1/2, qui s'introduisent sans conducteur et à l'aide du cystoscope du Prof^r Albarran.

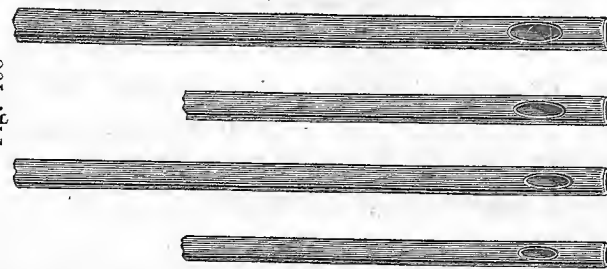


Fig. 160

La fig. 160 représente la série de sondes avec pavillon, grosseurs naturelles, n°s 8, 9, 10, 11, 12, 13 de notre filière, que l'on peut introduire à l'aide de notre conducteur. — Les sondes pour femme mesurent 55 centimères, et celles pour homme 70 centimètres. — Ces sondes sont ouvertes à l'extrémité avec le bout légèrement arrondi.

Nous ne croyons pas devoir insister ici sur la manière dont nous construisons ces instruments, indispensables pour faire, dans de bonnes conditions, le cathétérisme urétéral, non plus sur les procédés techniques de leur fabrication ; il nous suffira de dire que nous avons été guidé par les conseils de M. le Prof^r Albarran, et que les explications qu'il nous a données avec sa bienveillance habituelle, nous les avons observées très rigoureusement.

Les conducteurs, modèles Gaillard, sur lesquels on glissera ces sondes, sont construits en baleine première qualité, bien finis, avec une partie souple à l'extrémité en tissu de soie très solidement fixée par notre système de greffage, modèle exclusif de notre maison.

257 **Cystoscope**, modèle du Prof[r] Albarran, à l'aide duquel se pratique le cathétérisme des urétères. . . . . prix **320** »

258 **Sonde** urétérale, pour pratiquer le cathétérisme de haut en bas, voir fig. 151 *bis* et 159 . . . . à **4** »

Tubes en cristal fort pour contenir les sondes urétérales

259 **Tube** en cristal fort, longueur 75 c/m 30 m/m. de diamètre, avec bouchon caoutchouc. **3 50**

260 **Gaine** en fer peint, pour la préservation du tube de 30 m/m . . . . **4** »

261 **Tube** en cristal fort, de 75 c/m 40 m/m de diamètre. . . . . **6** »

262 **Gaine** en fer peint, pour le tube de 40 m/m. . . . . **5** »

Sur demande, nous fournirons des gaines ou fourreaux pour ces tubes, en métal nickelé ou recouverts en peau.

Tubes pour sondes uréthrales et instruments divers pour voies urinaires
(Voir page 47).

Électricité, Électrolyse linéaire




Fig. 161

263 **Tige** électrique avec série d'olives, du Prof[r] Guyon (fig. 161). . . . . **22** »

263 *b* — — de 6 ou 9 olives . . . . **15** et **18** »

264 **Tige** seule à fil conducteur à l'intérieur . . . . la douz. **24** »

265 **Bougie** électrique de Mallez **4 50**



Fig. 162

266 **Bougie** électrolytique avec olive de Newmann, modèle Gaillard (fig. 162), l'une **4 50**

Ces séries de bougies et d'olives électrolytiques pourront être composées suivant les indications de nos clients.

266 *b* **Série** de 12 bougies (fig. 162), n[os] 9 à 20 de notre filière . . . . prix **54** »

267 **Série d'olives** de Newmann, en maillechort, n[os] 9 à 20 . . . . **25** »

268 **Série d'olives** de Newmann, en argent, 9 olives graduées, n[os] 12 à 20 . . . . **45** »

269 Même série d'olives, en platine . . . . **110** »

270 **Bougie** seule à fil conducteur, pour la fig. 162. . . . . la douz. **18** »



Fig. 162 *b*.

270 *b* **Excitateur utérin** du D[r] A. Tripier (fig. 162 *bis*) **6 50**

Excitateurs de tous modèles pour le rectum, l'urèthre, la vessie, le vagin et l'utérus. . . . . prix de **6** à **45** »

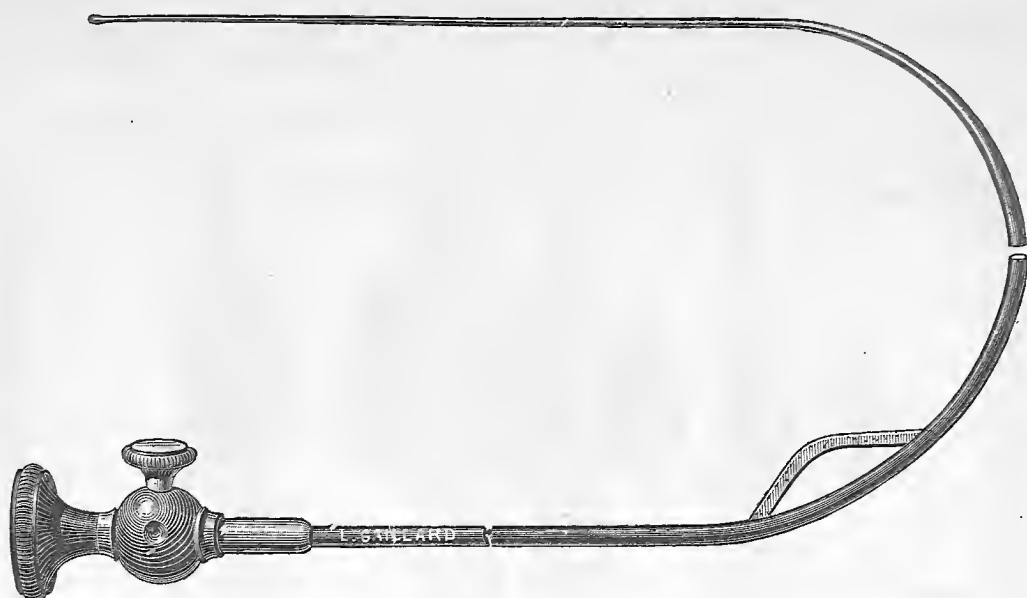


Fig. 163

271 **Electrolyseur** uréthral du Dr Fort, à conducteur filiforme, couteau en platine, nos 15 à 30 de notre filière (fig. 163) . . . . de **15** à **20** »

272 **Electrolyseur** uréthral, le conducteur raccordé avec pas de vis. . . . . **12** »

273 **Electrothome** électrolyseur du Dr Schmeltz, de Nice, même dispositif que la figure 163 . . . . **18** »

274 **Electrolyseur** du Dr Bazènerie, même dispositif que fig. 163. . . . . **15** »




Fig. 163 *b*.

275 **Uréthrotome-Cautère électrolyseur** des Drs Lavaud et Dève (fig. 163 *b*.), le couteau-platine à sommet large et des nos 15 à 30 de notre filière. . prix **18** à **25** »

276 **Electrolyseur** pour l'œsophage, grande lame en maillechort . . . . **15** »

277 **Electrolyseur** pour le rectum, grande lame maillechort. . . . . **15** »

278 **Garnissage** des électrolyseurs (fig. 163), **6** ». — Du no 272, sans conducteur. **4** »

Maladies de l'Estomac et de l'Œsophage

Sondes et Bougies œsophagiennes, Dilatateurs divers

279 **Bougie** œsophagienne cylindrique . . . . la douz. **21** »
Série du no 9 à 36, 12 m/m.

280 **Bougie** œsophagienne cylindro-conique, du Profr Bouchard, de la filière nos 7 à 30 (fig. 164). . . . . **27** »

281 **Bougie** œsophagienne cylindro-conique du Dr Bouchard (fig. 164), 11 à 25 m/m. **36** »

282 Série complète de 39 bougies Bouchard (fig. 164), numérotées de 7 à 45, 25m/m, pour **90** »

283 Série no 2, 24 bougies (fig. 164), les numéros impairs de 7 à 29 sont supprimés, **60** »

284 **Bougie** œsophagienne olivaire, nos 7 à 30 (fig. 165) . . . . la douz. **30** »

285 **Bougie** œsophagienne olivaire (fig. 165), de 11 à 25 m/m. . . . . . . — **42** »

286 **Série** complète de 39 bougies olivaires (fig. 165), numérotées de 7 à 45, 25 millimètres. . . . . **110** »

287 **Série** no 2, 24 bougies olivaires (fig. 165) . . . . **75** »

288 **Bougie** œsophagienne plombée . . . . en plus par douz. **6** »

289 **Bougie** œsophagienne olivaire, à renflement ou à ventre, du Dr Strauss, 8 à 16 millimètres . . . . la douz. 36 »

290 La même, de 16 à 25 millimètres. . . . . 48 »

Ces bougies à ventre sont faites avec le même dispositif que pour la bougie uréthrale fig. 42, page 9.

291 **Série** complète des bougies du Dr Strauss, 8 à 25 millimètres. . . . . 60 »

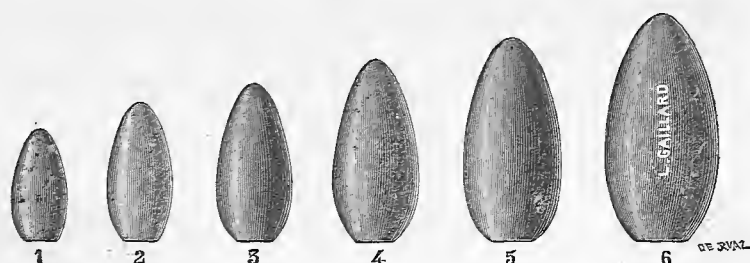


Fig. 166

292 **Dilatateur** en baleine, 6 olives buffle, de Trousseau (fig. 166). . . . . 15 »

293 **Dilatateur** de Trousseau, avec 6 olives ivoire (fig. 166). . . . . 22 »

294 **Dilatateur** œsophagien du Professeur Verneuil, avec conducteur et 6 olives dilatatrices . . . . 28 »




Fig. 167

295 **Dilatateur** œsophagien du Dr Richet (fig. 167), avec la série de six bougies montées, de 8 à 13 millimètres, complet. . . . . 25 »

296 **Bougie** plombée du Dr Richet, avec armature pour ce dilatateur . . . . 3 »

Gavage, alimentation forcée, Lavages de l'estomac, Sondes œsophagiennes diverses

297 **Sonde** œsophagienne cylindrique (fig. 168). . . . . la douz. 24 »

298 **Sonde** œsophagienne olivaire (fig. 169) . . . . la douz. 30 »

299 **Sonde** œsophagienne à béquille, du Dr Cotard (fig. 170) . . . . — 30 »

300 **Sonde** œsophagienne percée du bout . . . . — 24 »

301 **Bougie** conductrice double pour la sonde ci-dessus. 4 50

Nous faisons les sondes œsophagiennes ci-dessus aux longueurs suivantes : 50, 55, 60, 70 et 80 centimètres et des nos 9 à 45, 15 millimètres; demandées exclusivement dans les gros numéros, ces sondes subiront une augmentation par douz. de 6 »

Sondes œsophagiennes en tissu de soie très souples pour l'alimentation naso-pharyngienne

302 **Sonde** œsophagienne cylindrique en soie (fig. 168) . . . . la douz. 36 »

303 **Sonde** œsophagienne olivaire en soie (fig. 169). . . . . la douz. 42 »

304 **Sonde** œsophagienne à béquille, du Dr Cotard, en soie (fig. 170). . . . . 42 »

Nous faisons ces sondes en tissu de soie de même qualité que nos sondes uréthrales et des nos 15 à 24 de notre filière. Elles présentent les mêmes avantages et qualités énoncés à notre notice page 21.

Sondes œsophagiennes en caoutchouc vulcanisé

305 **Sonde** naso-pharyngienne en caoutchouc vulcanisé, des Drs Verneuil et Crisabert. . . . . la douz. 30 »

306 **Sonde** œsophagienne en caoutchouc vulcanisé, 55 centimètres environ. . . . . 36 »
La même, 65 centimètres environ. . . . . 45 »

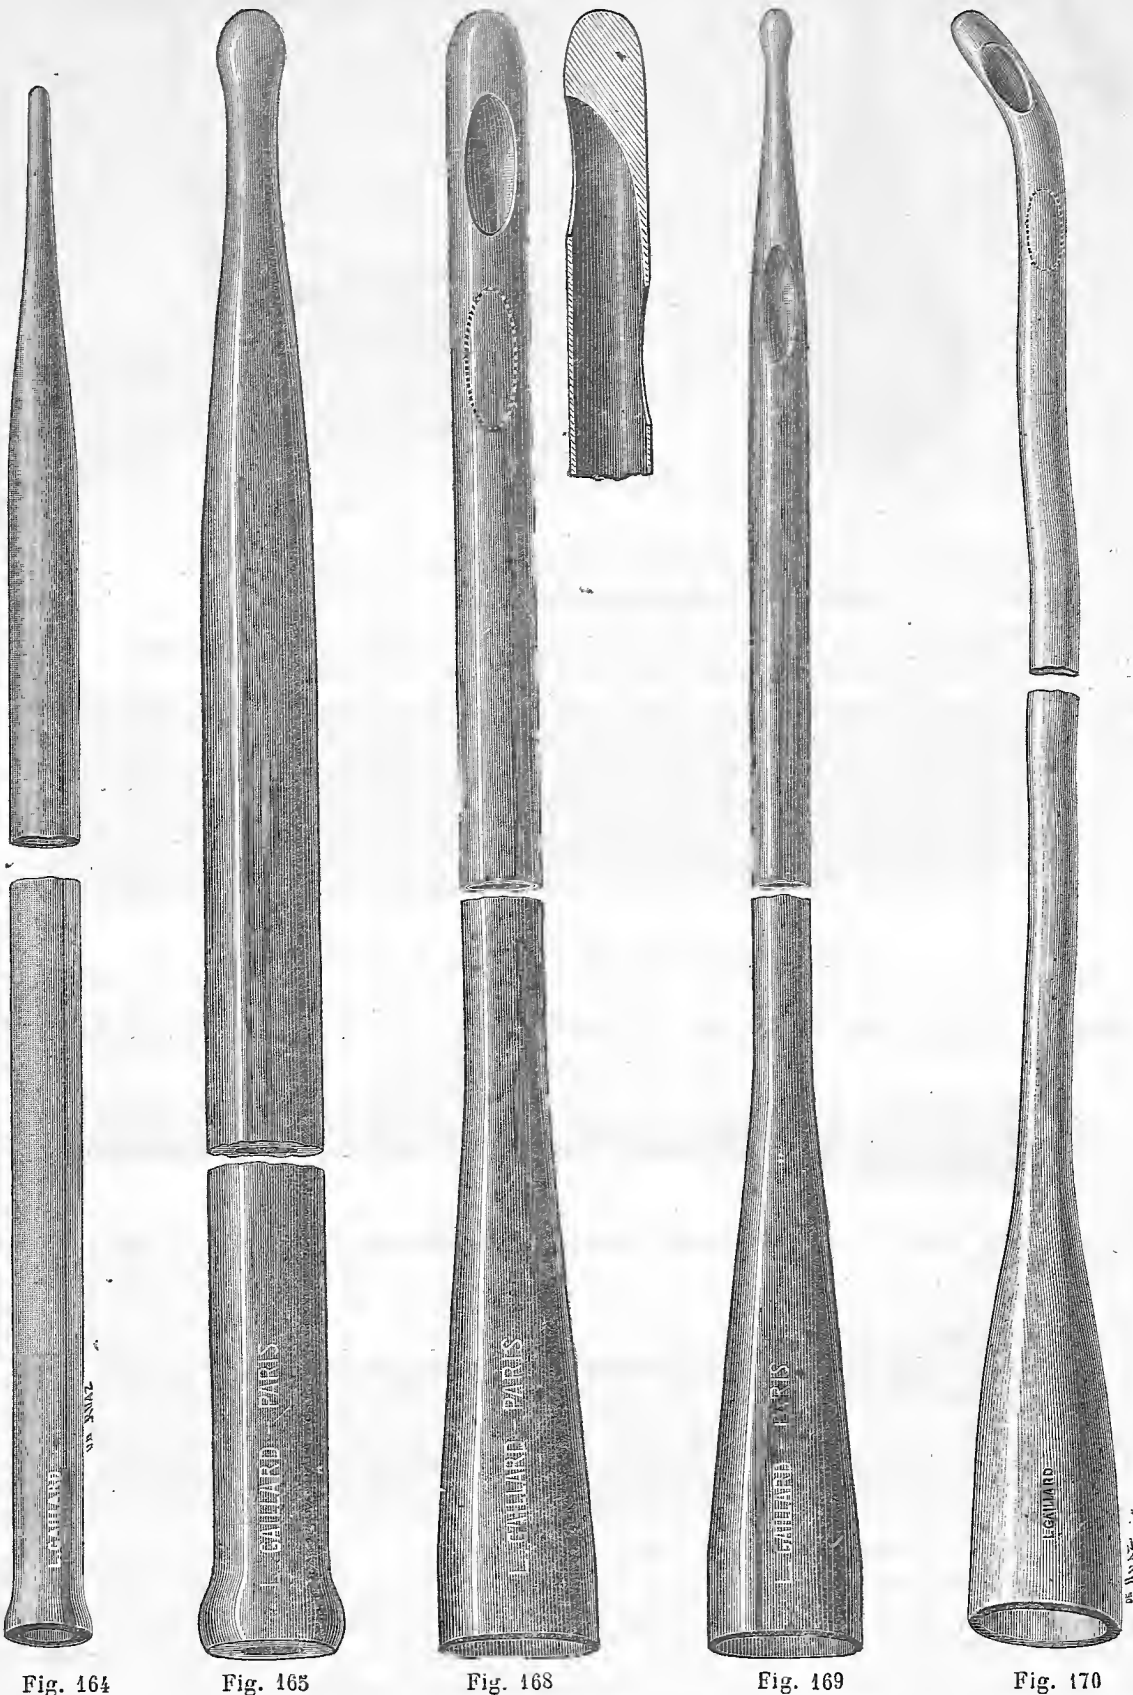


Fig. 164 Fig. 165 Fig. 168 Fig. 169 Fig. 170

307 **Sonde** œsophagienne en caoutchouc vulcanisé, avec pavillon. . . la douz. 36 à 48 »
308 **Tubes** pour lavages de l'estomac du Dr Faucher, 3 nos, 8, 10 et 12 millimètres . 6 »



Fig. 174

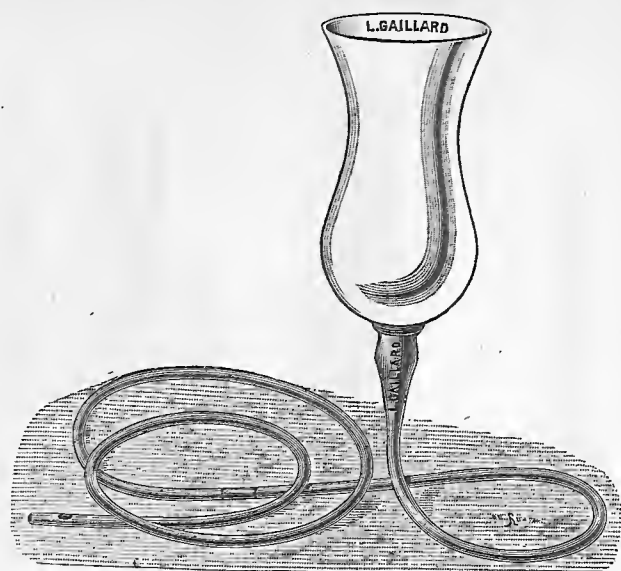


Fig. 171

309	**Tube** du Dr Faucher, avec entonnoir, appareil complet en boîte (fig. 171). . . .	8	»
310	**Tube** du Dr Faucher, moulé en caoutchouc pur	8	»
311	**Tube** du Dr Debove, raccord métallique avec sonde moulée.	10	»
312	**Tube** du Dr Debove, avec entonnoir, appareil complet en boîte.	12	»
313	**Sonde** moulée de rechange, pour tube Debove	5	»
314	**Tube** à double courant, formant siphon, du Dr Mauduis, ...	12	»
315	**Entonnoir** en métal nickelé, pour les tubes à lavage de l'estomac.	5	»

Fosses nasales et Trompe d'Eustache

Sondes ou canules pour trajets fistuleux de 12 à 25 centimètres assortis, nos 3 à 8 de la filière



Fig. 172

316	**Sonde** droite, pour la trompe d'Eustache ou trajets fistuleux, du Dr Deleau (fig. 172) . . . . la douz.	12	»



Fig. 173

316 *b*	**Sonde** à béquille, pour la trompe d'Eustache, des Drs Weber et d'Itard, (fig. 173). . . . . la douz.	13	50
317	**Sonde** d'Itard en caoutchouc durci (fig. 173) . . . . la douz.	15	»
318	**Sonde** d'Itard-Weber en métal nickelé.	18	»
319	**Conducteur** filiforme, gradué, pour cathétérisme avec la sonde ci-dessus . . .	12	»
320	**Siphon** nasal du Dr Weber, avec poire d'amorcement, canule caoutchouc durci, ou porcelaine.	8	»
321	**Siphon** nasal simple, avec canule caoutchouc durci ou porcelaine	5	»
322	**Poire** de Pollitzer, avec canule simple (fig. 174).	9	»
323	**Poire** de Pollitzer, avec deux canules.	10	50
324	**Canule** à olive, pour oreille, en gomme . . . . la douz.	12	»




Fig. 175

325 **Canule** nasale à boule, de Piorry (fig. 175). . . . . la douz. **15** »
326 **Canule** pharyngo-nasale du Dr Puistienne, pour irrigations des fosses nasales d'arrière en avant . . . . la douz. **18** »
327 **Canule** nasale, coudée, du Dr Madeuf. . . . . la douz. **15** »
328 **Canule** excentrique pour le nez, du Dr Duplay, en caoutchouc durci ou porcelaine . . . . la douz. **9** »




Fig. 176

329 **Canule** en cristal pour le nez ou les oreilles, modèle Gaillard (fig. 176). la douz. **9** »

Maladies du rectum et de l'intestin

Dilatateurs du rectum, Bougies, Canules ou sondes rectales




Fig. 177

330 **Canule** rectale cylindrique en gomme, série de 10 à 30 mill. (fig. 177). la douz. **24** »
331 **Canule** rectale très souple, cylindro-conique en gomme, de 10 à 25 millimètres. . . . . la douz. **30** »


Fig. 178

332 **Canule** rectale très souple, cylindro-conique olivaire, du Dr Bazy, série de 10 à 25 millimètres (fig. 178). . . . . la douz. **30** »
333 **Dilatateurs** du rectum, cylindriques, coniques ou olivaires, nos 15 à 30 de la filière, assortis. . . . . la douz. **15** »




Fig. 179

334 **Canule** rectacle cylindrique, en caoutchouc vulcanisé (fig. 179), la douz. assortie **36** »
335 **Canule** rectale cylindrique, en caoutchouc vulcanisé, de 25 à 30 millim., la pièce **4 50**
336 **Canule** rectale cyliudro-conique, en caoutchouc vulcanisé (fig. 179), la d. assortie **36** »
La même, de 25 à 30 millimètres **4 50**
337 **Mandrins** dilatateurs de Hégar, en caoutchouc durci, suivant grosseur, de 2 à **6** »

Nos 2 à 5	6 à 10	11 à 15	16 à 20	21 à 25	26 à 30
2 »	**2 50**	**3 »**	**3 50**	**4 50**	**5 50**

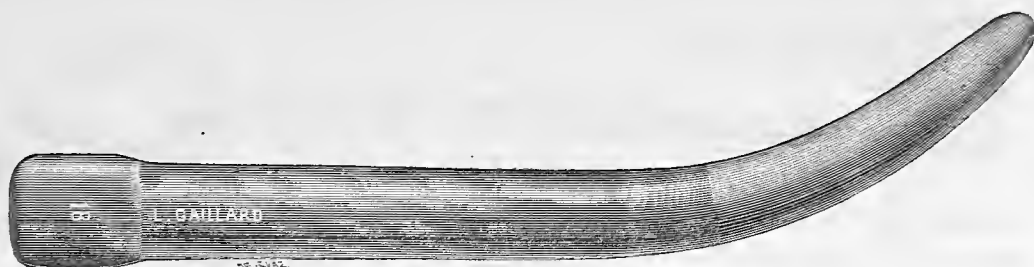


Fig. 180

338 **Dilatateur** utérin, de Hégar, en gomme, à portion souple, modèle Gaillard, de 3 à 12 millimètres (fig. 180), construit sur les indications du Dr J. Janet. . . **1 75**

339 Le même, de 13 à 25 millimètres . . . . **3 »**




Fig. 181

340 **Dilatateur** de Hégar, en métal nickelé (fig. 181) . . . . **3** » à **8 »**

Canules pour lavement et lavage intestinal en gomme polie et caoutchouc vulcanisé




Fig. 182

341 **Canule** olivaire à lavement, à portion très souple, du Dr Reliquet assorties de longueurs, 20 à 30 centimètres, modèle Gaillard (fig. 182) . . . . la douz. **15 »**



Fig. 183

342 **Canule** droite à lavement pour enfant, première qualité, assorties de 8 à 15 centimètres (fig. 183 et 184) . . . . la douz. **4 50**

La même, en gomme blonde . . . . la douz. **6 »**



Fig. 184

342 *b* **Canule** droite pour enfant, deuxième qualité . . . . la douz. **3 »**

343 **Canule** olivaire à lavement, pour enfant, première qualité, 8 à 15 centimètres douz. **5 »**



Fig. 185

343 *b* La même, en gomme blonde . . . . la douz. **6 »**




Fig. 186

344 **Canules** pour enfant, olivaire ou droite, à large godet (fig. 186) . . . . la douz. **6 »**

345 **Canules** droites pour lavement, première qualité, assorties, 10 à 15 cent. la douz. **6** »



Fig. 187

346	Les mêmes, assorties, 15 à 20 centimètres (fig. 187)			la douz.	**7 50**
347	—	—	20 à 30 —	—	**9** »
348	—	—	30 à 40 —	—	**12** »
349	—	—	40 à 50 —	—	**15** »
350	—	—	50 à 60 —	—	**18** »
351	**Canule** courbe sans olive, de 20 à 25 centimètres			—	**9** »

352 **Canules** droites, qualité ordinaire

	10 à 15	15 à 20	20 à 25 centimètres
la douz.	**3 50**	**5** »	**6 50**




Fig. 188

353	**Canules** olivaires à lavement, première qualité (fig. 188), 10 à 15 cent., la douz.		**7 50**
354	**Canule** olivaire à lavement, 15 à 20 centimètres	—	**9** »
	La même, de 20 à 30 centimètres	—	**12** »
	— 30 à 40 —	—	**15** »
	— 40 à 50 —	—	**18** »
355	Toutes ces canules livrées en gomme blonde	en plus par douz.	**2** »
356	**Canule** cylindro-conique pour lavement, en gomme blonde, 15 à 20 cent., la douz.		**9** »




Fig. 189

357	**Canules** en gomme souple, pour lavage intestinal, forme droite ou à olive (fig. 189), assorties, de 30 à 50 centimètres	la douz.	**18** »
358	**Canule** ou **sonde** en caoutchouc, pour enteroclysme, 30 à 40 centim.	—	**30** »
	La même, de 40 à 50 centimètres	—	**42** »



Fig. 190

359 **Canule** ou **sonde** en gomme souple, conique olivaire (fig. 190). . . . — **30** »

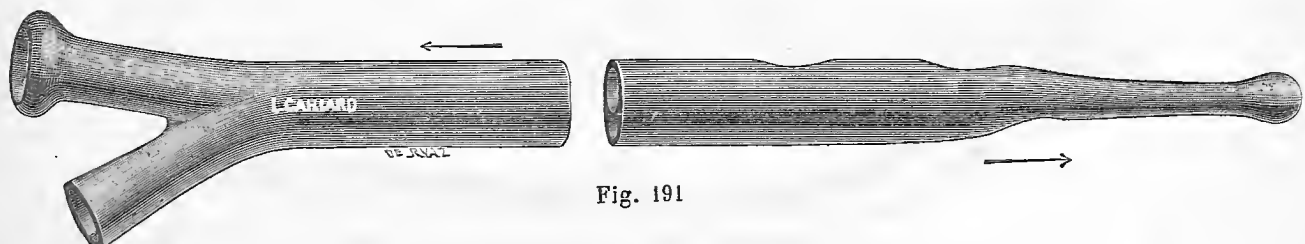


Fig. 191

360	**Sonde** ou **canule** rectale à double courant, conique olivaire, modèle Gaillard. (fig. 191)	la douz.	**48** »
361	**Sonde** rectale à double courant, forme cylindrique, modèle Gaillard.	—	**36** »

362 **Canules** pour lavements, en caoutchouc vulcanisé cylindriques.

Long.	8	10	12	15	20	25	30	40	centim.
Prix	**6** »	**7** »	**8** »	**10** »	**12** »	**15** »	**18** »	**24** »	la douz.

363 **Canules** pour lavements, en caoutchouc vulcanisé, cylindrique à godets.

Long.	8	10	12	15	20	25	30	40	centim.
Prix	**7** »	**8** »	**9** »	**12** »	**15** »	**18** »	**24** »	**27** »	la douz.

364 **Canules** pour lavements, en caoutchouc vulcanisé, olivaire.

Long.	12	15	20	25	30	40	50	centim.
Prix. Fr.	**9** »	**12** »	**15** »	**18** »	**21** »	**30** »	**36** »	la douz.




Fig. 192

365 **Canules** olivaires et à godet, en caoutchouc vulcanisé (fig. 192).

Long.	15	20	25	30	40	50	centim.
Prix. Fr.	**15** »	**18** »	**21** »	**27** »	**36** »	**42** »	la douz.

Canules pour injections, en gomme polie, en caoutchouc vulcanisé et en cristal.

366 **Canule** courbe, pour injections, en gomme noire . . . . la douz. **6** »

366 *b*. **Canules** courbes à injections, gomme noire (série B). . . . . à **3 50** et **4 50**


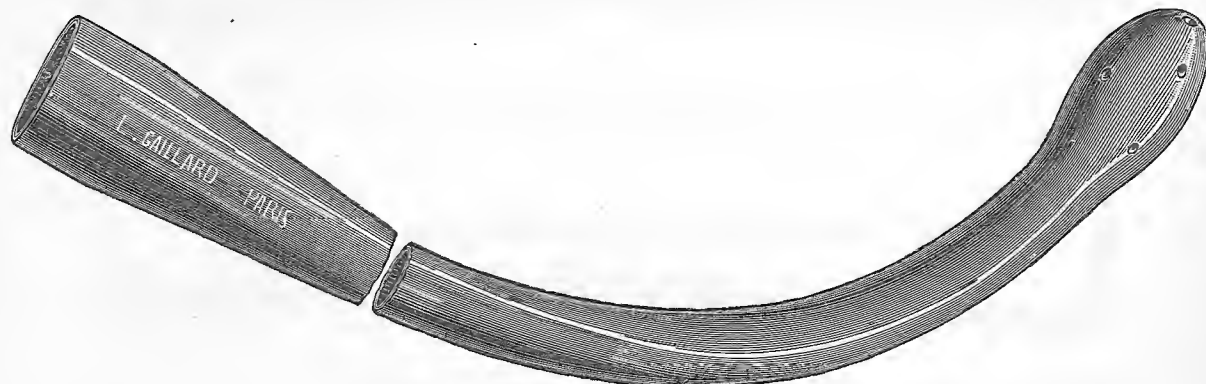


Fig. 193

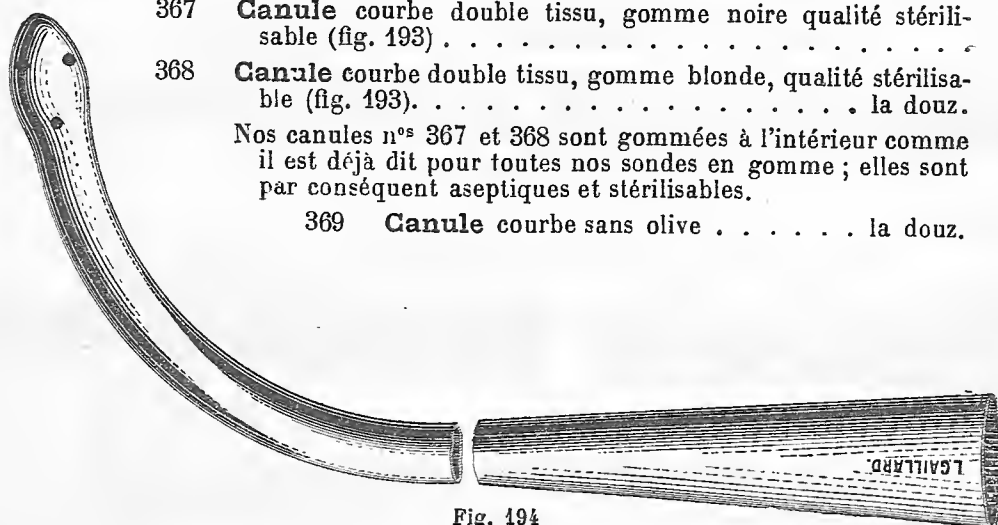

367 **Canule** courbe double tissu, gomme noire qualité stérilisable (fig. 193) . . . . **9** »

368 **Canule** courbe double tissu, gomme blonde, qualité stérilisable (fig. 193). la douz. **12** »

Nos canules n°s 367 et 368 sont gommées à l'intérieur comme il est déjà dit pour toutes nos sondes en gomme ; elles sont par conséquent aseptiques et stérilisables.

369 **Canule** courbe sans olive . . . . . . la douz. **7 50**

Fig. 194

370 **Canule** courbe à injections, pour fillette (fig. 194). . . . . la douz. **7 50**

371	**Canule** courbe à injections, gomme blonde, pour fillette (fig. 194) . . .	la douz.	**9**	»
372	**Canule** olivaire droite, pour injection	—	**6**	»




Fig. 195

373	**Canule** olivaire droite pour injection, double tissu (fig. 195).	la douz.	**7**	**50**
374	**Canule** olivaire droite pour injection, double tissu, gomme blonde qualité stérilisable.	—	**9**	»
375	**Canule** olivaire droite, à injection, pour fillette	—	**7**	**50**
376	**Canule** — à injection, gomme blonde, pour fillette.	—	**9**	»
377	**Canule** — pour énéma, gomme noire	—	**6**	»
378	**Canule** — — gomme blonde.	—	**9**	»




Fig. 196

379	**Canule** olivaire pour injections, du Dr Martineau (fig. 196).	la douz.	**18**	»
380	**Canule** à grosse olive cylindrique, dite de Savignac	—	**18**	»
381	**Canule** à injection, de M. Vernier	—	**15**	»
382	**Canule** — de Mme Lachapelle	—	**15**	»
383	**Canule** en caoutchouc vulcanisé, pour injections, courbe à godet . . .	—	**15**	»



Fig. 197

384	**Canule** en caoutchouc vulcanisé, droite courte, pour injections (fig. 197).	la douz.	**9**	»
384 *b*	**Canule** — longue, —	—	**12**	»




Fig. 198

385	**Canule** en caoutchouc vulcanisé, droite longue, à godet (fig. 198).	**15**	»
386	**Canule** en caoutchouc et olive cylindrique, percée de 16 trous	**18**	»
387	**Canule** en caoutchouc à olive, percée de 4 fentes ou œillets	**18**	»
388	**Canule** en caoutchouc vulcanisé, à godet cylindrique pour fillettes	**9**	»

389 **Canule** droite, 5 trous, en cristal fort, pour injection **4 50**
390 **Canule** courbe, 5 trous, en cristal fort . . . . **5 »**
391 **Canules** cylindrique, en cristal fort, du Dr Pozzy, droites ou courbes . . . . . **8 »**




Fig. 199

392 **Canule** en cristal, à double courant, avec obturateur en caoutchouc (fig. 199). . **6 »**

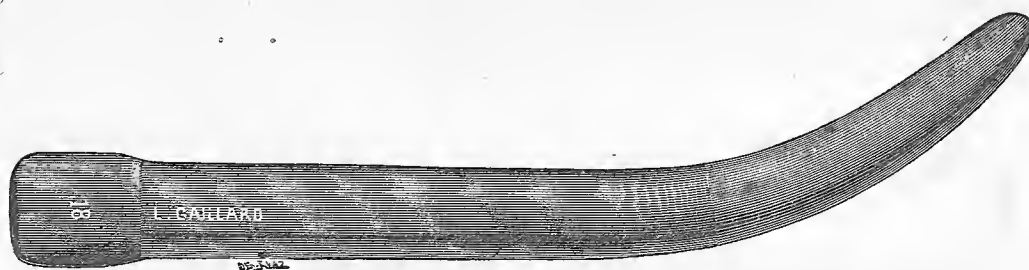


Fig. 200

393 **Dilatateurs** utérins du Dr Janet, modèle Gaillard, 3 à 12 millimètres (fig 200). **1 75**
393 *b* **Dilatateurs** utérins du Dr Janet, modèle Gaillard, 13 à 15 millimètres. . . . . **3 »**
394 **Dilatateurs** utérins de Hégar, en caoutchouc durci, suivant grosseur . **2 50** à **6 »**
395 **Dilatateurs** utérins — en métal nickelé — — . . . **3 50** à **8 »**
396 **Tiges** laminaires, assorties. . . . . la douz. **9 »**

Maladies des femmes

Pessaires en gomme noire, caoutchouc et divers




Fig. 201




Fig. 202

397 **Pessaires** en gomme noire, rond ou ovale (fig. 201-202) . . . . la douz. **12 »**

398 **Pessaires** rond ou ovale, à cuvette, gomme noire . . . . la douz. **18** »
399 **Pessaires** rond ou ovale, à tige . . . . — **24** »
400 **Pessaires** rond ou ovale, à tige et à cuvette. . . . . — **30** »
401 **Pessaires** forme bondon. — **24** »



Fig. 203



Fig. 204

402 **Pessaire** anneau du Dr Dumontpallier (fig. 203) . . . la pièce **3** fr. **50**, la douz. **24** »
403 **Pessaire** anneau sans ressort **2 50**
404 **Pessaire** anneau et à membrane . . . . **4** »
405 **Pessaire** anneau avec fond plat, caoutchouc rouge ou noir (fig. 204). . . . . . **3** »
406 **Pessaire** anneau avec fond, en forme chapeau . . . . **3** »




Fig. 205

407 **Pessaire** à air, forme pelote, du Dr Gariel (fig. 205). **3 50**



Fig. 206



Fig. 207

408 **Pessaire** forme gimblette, rondon ovale (fig. 206) **3 50**
409 **Pessaire** forme cuvette . . . . **5** »
410 **Pessaire** forme cuvette et à diaphragme . . . . la pièce **6** »
411 **Pessaire** à rétroversion simple. . . . . — **4** »
412 **Pessaire** à rétroversion à cuvette. . . . . la pièce **5** »
413 **Pessaire** à air fixe, caoutchouc gris ou rouge. . . . . — **2 50**
414 **Insufflateur** pour gonfler les pessaires (fig. 207) . . . . la pièce **3 50**





Fig. 208


Fig. 209

415 **Pessaire** de Hodge, en caoutchouc durci (fig. 208) . . . . la douz. **18** »
416 **Pessaire** en aluminium, de Sims, 7 numéros (fig. 209). . . . . la pièce **5** »

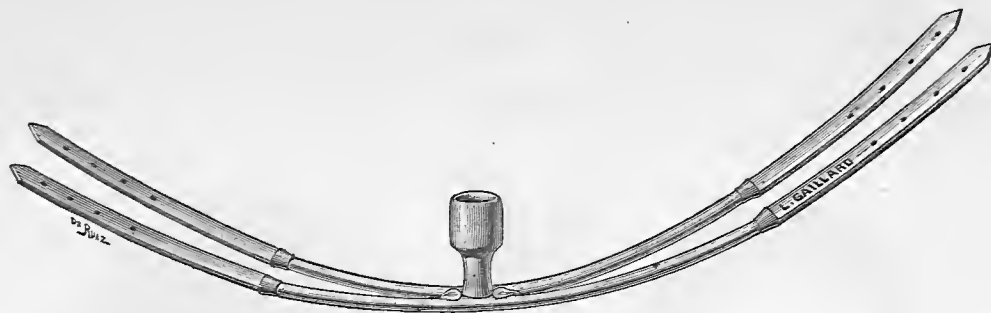


Fig. 210

417 **Pessaire** releveur de Borgnier avec ceinture (fig. 210) . . . . la pièce. **15** »

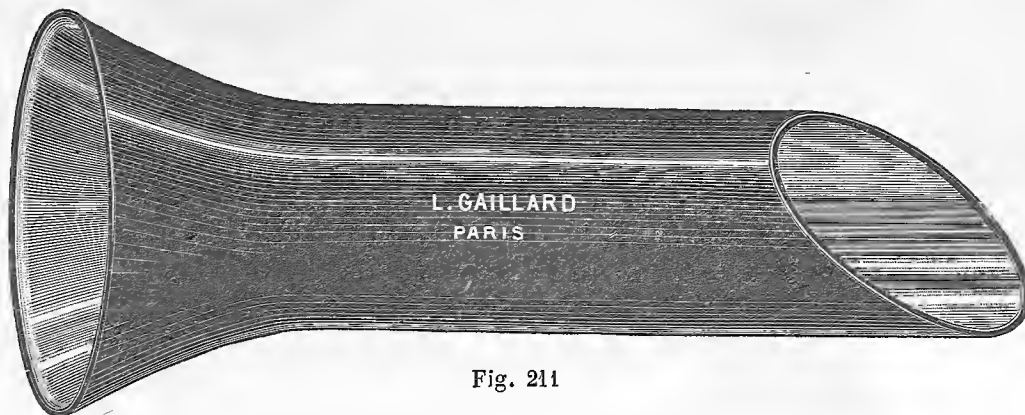


Fig. 211

418 **Spéculum** à glace de Fergusson, nos 1, 2, 3 (fig. 211) . . . . la douz. **30** »
419 **Spéculum** Fergusson, recouvert d'un tissu protecteur . . . . — **48** »
420 **Spéculum** pour bains, du Dr Gendron, en caoutchouc durci . . . . . — **36** »
421 **Spéculum** pour bains, du Dr Gendron, en gomme noire . . . . — **30** »
422 **Spéculum** pour bains, du Dr Martineau . . . . — **30** »




Fig. 212




Fig. 213

423 **Spéculum** grillagé de Siredey, pour bain local (fig. 212). . . . . . . la pièce **4 50**
424 **Spéculum** grillagé de Siredey, avec canule, pour douche locale (fig. 213) . . . **7 50**
425 **Spéculum** grillagé, avec canule et opercule, pour douche . . . . **12** »



Fig. 214

426 **Drain utérin** en gomme, du Dr Vaux (fig. 214), modèle Gaillard. . . . . . . **3** »

Bandages recouverts en gomme polie, qualité supérieure, de L. Gaillard

427 **Bandage** gomme noire simple, pour enfant, 28 à 45 centimètres (fig. 215). . . 4 50
428 **Bandage** gomme noire simple, pour cadet, 46 à 70 centimètres . . . . 6 »
429 **Bandage** gomme noire simple, pour adulte, 71 à 105 centimètres (fig. 215). . . 8 »




Fig. 215




Fig. 216

430 **Bandage** double brisé, gomme noire, pour enfant . . . . 6 »
431 **Bandage** double brisé, gomme noire, pour cadet. . . . . 8 »
432 **Bandage** double brisé, gomme noire, pour adulte . . . . 10 »
433 **Bandage** double à ressort circulaire, pour enfant (fig. 216) . . . . 6 »
434 **Bandage** double à ressort circulaire, pour cadet (fig. 216) . . . . 8 »
435 **Bandage** double à ressort circulaire, pour adulte (fig. 216). . . . . 10 »
436 **Bandage** ombilical, gomme noire, pour enfant. . . . . 5 »
437 **Bandage** ombilical, gomme noire, pour cadet . . . . 7 »
438 **Bandage** ombilical, gomme noire, pour adulte. . . . . 9 »
439 **Bandage** simple, à pelote anatomique, pour adulte. . . . . 9 »
Bandages fabriqués sur moulage ou sur mesure, augmentation de la moitié des prix ci-dessus.

Instruments et Appareils divers, pour voies urinaires

Tubes et Appareils divers pour conserver ou transporter les sondes



Fig. 217

Tubes en cristal fort, longueur 40 centimètres, avec bouchon caoutchouc à tête carrée

440 **Tube** n° 1, 20 millimètres de diamètre, avec ou sans tubulure, pour une ou trois sondes (fig. 217). 1 75
441 **Tube** n° 2, 30 millimètres de diamètre, pour 6 ou 9 sondes. 2 50
442 **Tube** n° 3, 35 millimètres de diamètre, pour 12 ou 18 sondes. . . . . 3 »




Fig. 218

443	**Tube** nº 4, 40 millimètres de diamètre, pour 18 à 24 sondes (fig. 218)	4 »

Gaines ou fourreaux pour transporter et préserver les tubes cristal

444	**Gaine** en fer peint, pour les tubes nº 2, 30 millimètres	3 »
445	**Gaine** en fer peint, pour les tubes nº 3, 35 millimètres.	3 50
446	**Gaine** en fer peint, pour les tubes nº 4, 40 millimètres	4 »
447	**Gaine** en métal nickelé, pour les tubes nº 2	6 »
448	**Gaine** en métal nickelé, pour les tubes nº 3.	8 »
449	**Gaine** en métal nickelé, pour les tubes nº 4.	10 »
450	**Gaine** en métal nickelé, recouverte en peau de maroquin, avec tube nº 3	10 »
451	**Gaine** en métal nickelé recouverte en peau de maroquin avec le tube cristal nº 4,	15 »
	(Constitue une véritable petite trousse pouvant contenir l'arsenal d'urgence ; 24 à 30 sondes et bougies assorties). . . . . Prix.	15 »

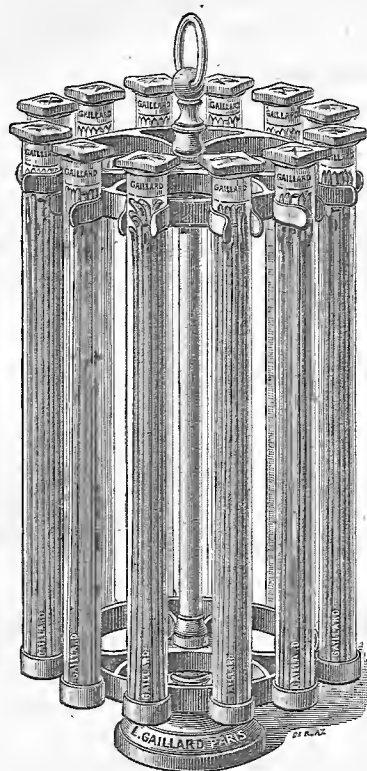


Fig. 219

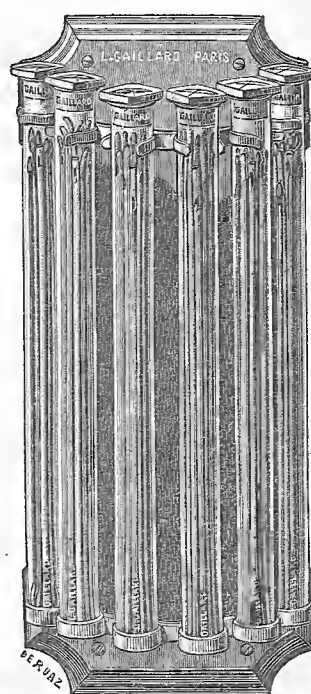


Fig. 220

452	**Support** tournant à pivot, sur socle, pour 6 tubes. (fig. 219).	35 »
453	**Support** tournant à pivot, sur socle, pour 9 tubes.	42 »
454	**Support** tournant à pivot, sur socle, pour 12 tubes (fig. 219).	50 »
455	**Support** métal nickelé demi-circulaire, sur planche murale, pour 6 tubes (fig. 220).	25 »
456	**Support** sur planches linéaires, pour 6 tubes	20 »
	Support sur planches linéaires, pour 9, 12, 15 ou 20 tubes ; en plus pour chaque tube .	3 »

Les tubes cristal ne sont pas compris dans le prix des supports, ces prix sont comptés pour tubes nº 2, de 30 millimètres ; ils subiront une augmentation de 0 50 à un franc par chaque tube de 35 ou 40 millimètres.

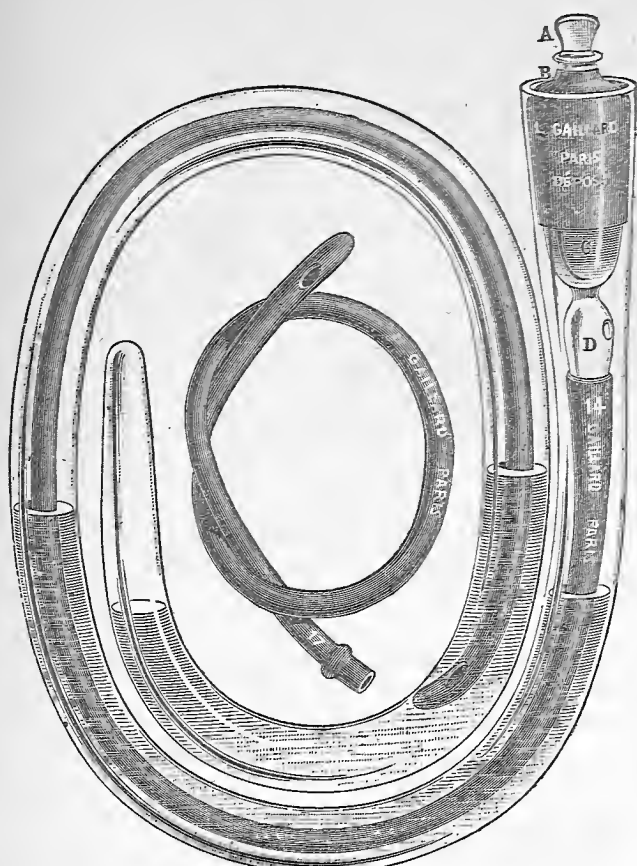


Fig. 221

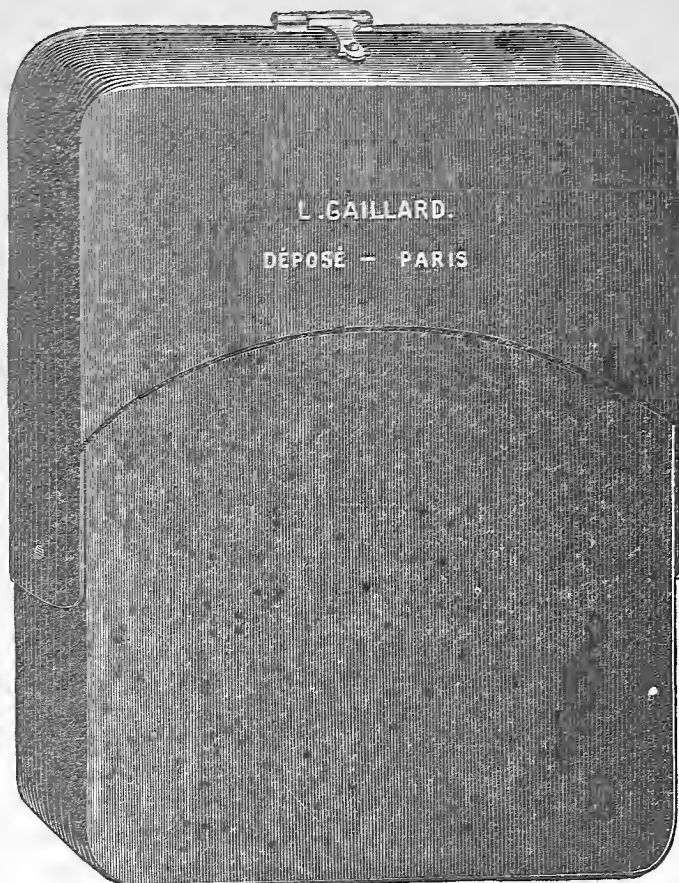


Fig. 222

457	**Tube** appareil de poche, modèle Gaillard (fig. 221).	**5**	»
458	**Appareil** porte-sonde, modèle Gaillard (fig. 221), dans son écran en caoutchouc durci (fig. 222). . . . . Prix	**10**	»
459	**Ecran** de poche, avec flacon, pour une sonde	**3**	»
460	**Ecran** de poche, avec plateau à réservoirs en métal nickelé stérilisable (fig. 223).	**5**	»
461	**Ecran** gainé en peau, plateau et réservoir à vaseline en métal nickelé stérilisable (fig. 223).	**7**	»
462	**Boîte** gainée, longueur 38 centimètres, pour 3 ou 6 sondes	**2**	»
463	**Boîte** gainée, longueur 42 centimètres, — avec flacon.	**3**	»

N. B. — Notre appareil, comme l'indique la fig. 221, est ainsi composé : en B, un tube en cristal à évasement, contenant une solution antiseptique où se trouve immergée une sonde coudée à béquille ; en A, bouchon à émeri ; C, flacon pour contenir l'huile phéniquée ou vaseline ; D, tubulure où s'adapte le pavillon de nos sondes ; B, chemise protectrice en caoutchouc.

Toutes nos sondes, des numéros moyens 9 à 22, rentrent facilement dans notre appareil ; mais il est indispensable d'y avoir préalablement introduit le liquide antiseptique en quantité suffisante, comme il est représenté (fig. 221) ; toutefois, par leur souplesse, nos sondes en caoutchouc vulcanisé de Nélaton et nos sondes souples en tissu de soie s'y introduisent avec la plus grande facilité.

Pour compléter nos renseignements, voici la façon la plus commode de se servir de notre appareil : 1° saisir le tube avec la main gauche, le goulot tourné vers la droite ; 2° enlever le flacon à vaseline qui bouche l'appareil ; 3° verser la première partie du liquide jusqu'au bord du tube ; 4° agir comme si l'on voulait faire sortir ce liquide par l'extrémité opposée, en renversant le tube de droite à gauche ; 5° cette première quantité de liquide ainsi poussée au fond du tube, le remplir de nouveau ; 6° fixer la sonde à la tubulure du flacon, qui est tenu de la main droite ; 7° glisser la sonde dans le tube en faisant une pression saccadée, à partir du moment où la pression régulière ne suffirait plus pour sa complète introduction. Nous pourrions même dire ce cathétérisme, car notre appareil ne peut être mieux comparé qu'à un canal antiseptique ; la forme qu'il imprime aux sondes facilite cette opération dans l'urèthre, aussi pour les sondes coudées ou à courbure nous recommandons de les introduire la partie convexe des sondes dans le sens de la concavité du tube, leur pointe suivant toujours la paroi supérieure.

Par simple mesure de précaution, le cercle intérieur de notre appareil peut contenir une sonde de rechange, ou mieux une compresse de linge, imbibée si l'on veut de solution antiseptique, qui pourra servir à essuyer la sonde avant de la remettre dans le tube, ou encore à aseptiser les doigts avant de l'en retirer. Notre appareil dans sa boîte (fig. 222) peut facilement être mis dans la poche, sa dimension est égale à celle d'un portefeuille moyenne grandeur.

Stérilisateurs, Bouilleurs, modèles Gaillard

Pour les sondes en gomme ou autres instruments



Fig. 224

464	**Stérilisateur** par ébullition, en tôle émaillée, petit modèle pour 6 à 30 sondes modèle Gaillard (fig. 224). . . . . Dimension de la cuve : longueur 42, largeur 10, hauteur 9 c/m.	18 »
465	**Stérilisateur** modèle ci-dessus, en nickel	48 »
466	**Stérilisateur** par ébullition (fig. 224), en tôle émaillée, petit modèle, avec fourneau en tôle émaillée	30 »
467	**Stérilisateur** par ébullition, en tôle émaillée, grand modèle (fig. 224), pour Cliniques, Hôpitaux ou Docteurs spécialistes. Dimension de la cuve : longueur 42, largeur 15, hauteur 12 cent.	25 »
468	**Stérilisateur** même modèle que ci-dessus, en nickel	65 »
469	**Stérilisateur** par ébullition, en tôle émaillée, grand modèle, avec fourneau (fig. 224)	40 »

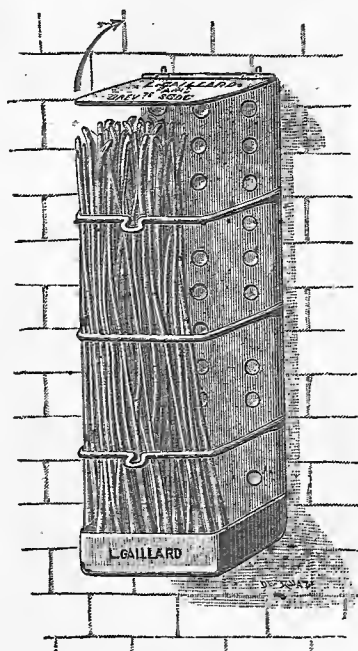


Fig. 225




Fig. 226




Fig. 227

470	**Lampe** à alcool, avec support (fig. 226), pour les bouilleurs, modèle Gaillard.	9 »
471	**Stérilisateur bouilleur**, petit modèle pour 5 à 6 sondes, comprenant une cuve, un panier ajouré, une lampe à alcool et une boîte à sondes, le tout en nickel .	45 »

La figure 225 représente le panier égoutoir ajouré, modèle Gaillard, contenant les sondes à stériliser que l'on plongera dans la cuve, l'eau étant en ébullition.

Trois à cinq minutes d'ébullition suffisent pour la stérilisation complète des sondes; l'ensemble de cette opération ne demande pas plus d'un quart d'heure avec notre stérilisateur.

Une note relative au mode d'emploi est jointe à chacun de ces appareils.

472	**Stérilisateur** par les vapeurs du formol, petit modèle en nickel	40 »
473	**Stérilisateur** par les vapeurs du formol, grand modèle, pour Cliniques ou Hôpitaux, en nickel.	120 »
474	**Tube** en cristal avec bouchon du Dr Desnos, pour la stérilisation des sondes au trioxyméthylène, chaque tube pouvant contenir environ 12 sondes.	5 »
475	**Stérilisateur-Formolateur Hélios**, modè A.	12 »
476	**Stérilisateur-Formolateur Hélios**, modè B.	18 »
477	**Pastilles** paraformiques . . . . le cent	7 50
478	**Bassin** émaillé, à cloisons mobiles, 3 compartiments, pour l'immersion des sondes.	18 »
479	**Bassin-cuvette** en porcelaine, 3 compartiments pour l'immersion des sondes.	18 »
480	**Boîte** en verre jaune, (fig. 227), pour immersion d'une sonde	3 75
481	**Boîte** à sondes, 6 tiroirs, 32 compartiments, pour 12 à 15 douzaines de sondes. Tout en noyer ciré, net : **30** fr.; en aulne verni. . . . . Net	22 »

Appareils pour injections, lavages et irrigations

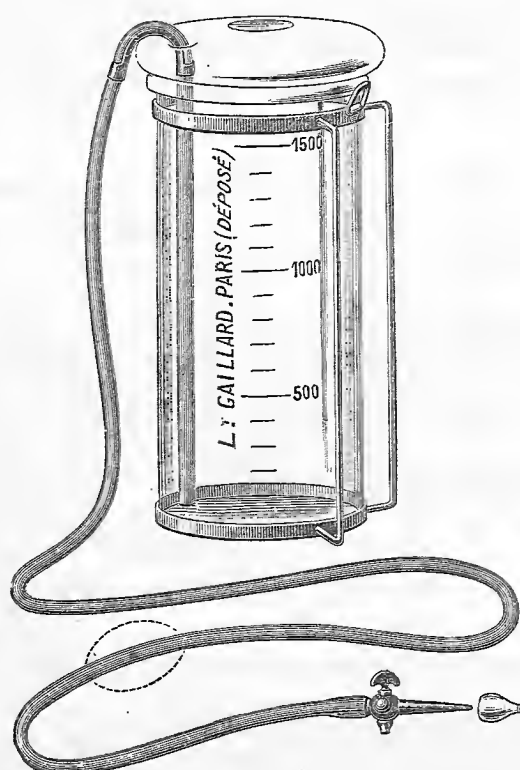


Fig. 228.

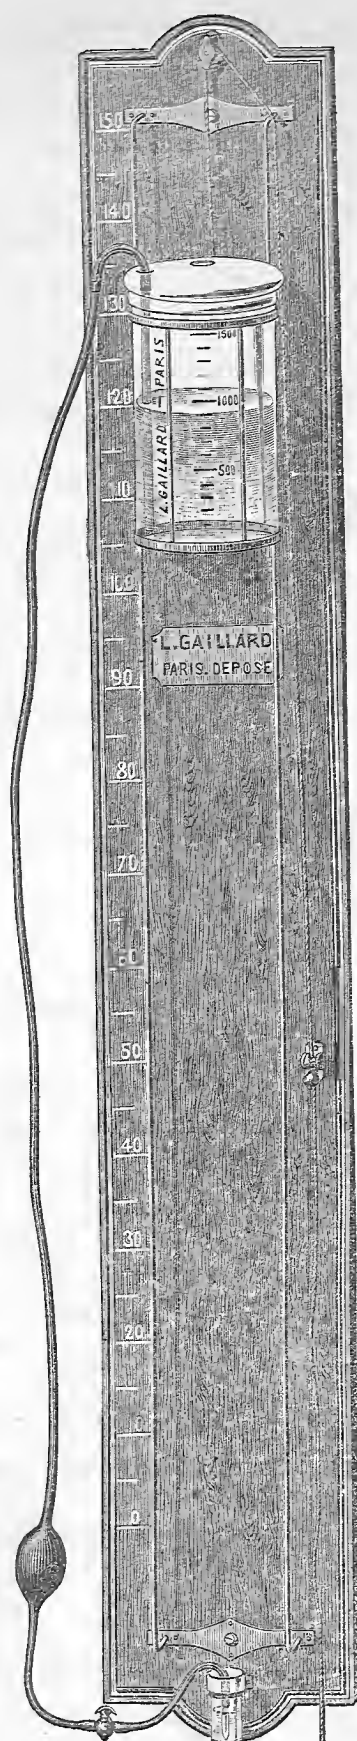


Fig. 229.

482	**Irrigateur Laveur** antiseptique, du Dr Witheside, modèle Gaillard (fig. 228).	18 »
482 *b*	**Irrigateur Laveur** en boîte gainerie	23 »
483	**Irrigateur Laveur** (fig. 228) contenant 2 litres	21 »
484	Ce même appareil, contenant 3 litres.	25 »
485	**Irrigateur Laveur** antiseptique, disposé à ascension, modèle Gaillard (fig. 229)	45 »

Cet appareil à ascension convient particulièrement pour cabinet de consultation, salle d'opérations ou clinique.

486 **Irrigateur Laveur** normal à thermomètre, du Dr Delefosse, modèle Gaillard, seul appareil permettant de pratiquer un lavage exactement à la température prescrite . . . . **28** »

487 **Laveur** vésical du Dr Duchastelet, tout caoutchouc, un litre . . . . complet. **28** »

488 Robinet à déversement, en caoutchouc durci, pour laveur. . . . . **15** »

Canules et Embouts pour lavage de l'urèthre et de la vessie, avec ou sans sondes



Fig. 230.

489 **Canules** uréthrales en cristal, du Dr Janet, 3 grandeurs (fig. 230) . . la douz. **4** »



Fig. 231

490 **Canules** uréthrales en cristal, du Professeur Albarran, 3 grandeurs (fig. 231), la douz. **4** »



Fig. 232

491 **Canules** uréthrales en cristal, du Dr Desnos, 3 grandeurs (fig. 232). . la douz. **4** »




Fig. 233




Fig. 234

492 **Canule** uréthrale en cristal, du Dr Lavau, avec ou sans olives (fig. 233, 234). la douz. **5** »

493 **Canule** uréthrale à protecteur en parachute, du Dr Tuffier (fig. 235) . . la douz. **7 50**




Fig. 235




Fig. 236



Fig. 237

494 **Embout** en verre ou porcelaine, du Dr Janet (fig. 236) . . . . **12** »

495 **Embout** olivaire en cristal pour seringue, modèle Gaillard (fig. 237), la douz. **9** »



Fig. 238


Fig. 239

496	**Embout** en verre, pour monter les sondes (fig. 238) . . . . la douz.	3	50
497	**Embouts** en caoutchouc durci, pour sonde, modèle Gaillard (fig. 239). la pièce	1	50

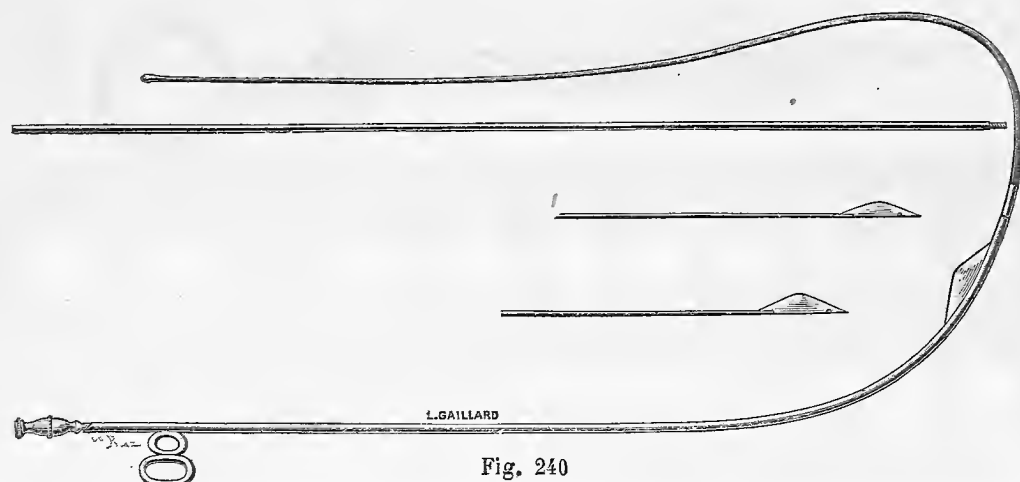


Fig. 240

498	**Uréthrotome** trois lames de Maisonneuve (fig. 240), avec 4 bougies conductrices		25	»
499	**Seringues à 3 anneaux, en maillechort nickelé**	60 gram.	12	»
	— — —	100 —	16	»
	— — —	150 —	20	»
	— — —	200 —	25	»
500	**Seringues** en métal nickelé et verre gradué.	100 —	20	»
	— — —	150 —	25	»

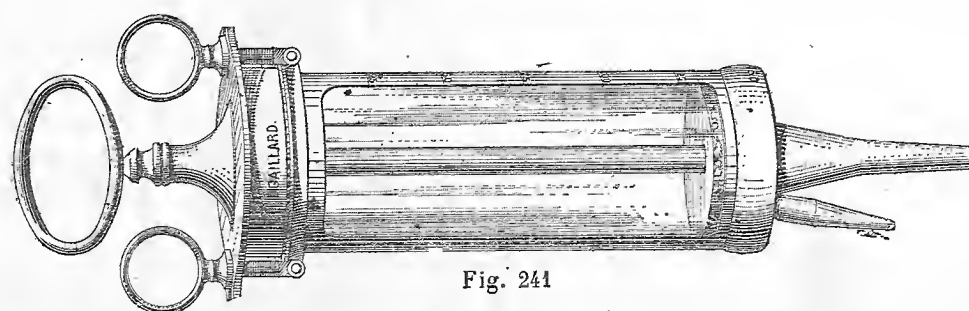


Fig. 241

501	**Seringues** en maillechort argenté et verre gradué, mod. Gaillard (fig. 241) 100 gr.	30	»
502	**Seringue** — — — (fig. 241) 150 —	33	»
503	**Cylindres** en cristal de rechange, pour ces seringues, 100 gr. **4 50** 150 —	5	»




Fig. 242

504 **Seringues** en caoutchouc durci rouge (fig. 242) 504 en caoutchouc durci noir

n° 2, Capacité	30	gram.	8	»	n° 2, Capacité	30	gram. . . .	7	»
n° 3 —	50	—	10	»	n° 3 —	50	—	8	»
n° 4 —	75	—	12	»	n° 4 —	75	—	10	»
n° 5 —	100	—	15	»	n° 5 —	100	—	13	»
n° 6 —	150	—	20	»	n° 6 —	150	—	18	»

505 **Seringue** en caoutchouc durci à 3 anneaux, le cylindre en verre. 100 gram. **16** »

506 **Seringue** — — — — 150 — **20** »

507 **Seringues** uréthrales ou vésicales en cristal, contenant 5 gram. **1 50**

Capacité 10 gram . . . . **2** » Capacité 50 — **3 50**

— 15 — . . . . **2 50** — 75 — **4 25**

— 25 — . . . . **3** » — 100 — . . . . **5** »



Fig. 243

508 **Seringue** uréthrale, verre et caoutchouc durci, du Dr Janet (fig. 243) **2 50**

La même, contenant 10 gram. . . **5** » La même 20 gram. . . . . . **7** »

509 **Seringue** pour insensibiliser le canal de l'urèthre par la cocaïne, modèle Gaillard. **3 50**

510 **Poires** en caoutchouc rouge, disposées pour lavages de l'urèthre ou de la vessie (fig. 244) contenant 75 gram. . . . . . **4** » contenant 150 gram. . . . . . **6** »

— 100 — . . . . . . **5** » — 200 — . . . . . **7** »

511 **Vide-bouteille** avec bouchon s'adaptant à n'importe quelle bouteille . . . . . **7** »

512 **Vide-bouteille** avec filet, modèle Gaillard. . . . . **9** »



Fig. 244

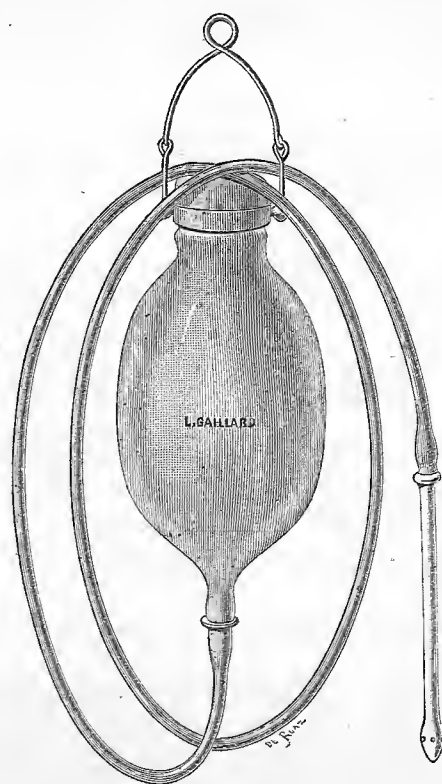


Fig. 245

513 **Poche-laveur**, tout caoutchouc pour voyage (fig. 245), contenant 1 litre, **10** » 2 litres, **12** » . . . . 3 litres, **15** »

514 **Bocks** en verre gradués, du Dr Pinard, accessoire complet, contenant 1 litre, **9** » ; 2 litres, **12** » . . . . 3 litres, **15** »

515 **Laveur** en verre gradué, forme d'entonnoir, contenant. . . . . 2 — **10** »

— — — . . . . 3 — **12** »

516 **Cloche** du Dr Tarnier, l'appareil complet, en verre gradué, 2 litres, 2 mètres tube caoutchouc. . . . . **8** »

517 **Douche** d'Esmarck, émaillé soigné et accessoires complet . . . . 1 litre **7 50**
— — — — . . . . 2 — **9 »**
— — — — . . . . 3 — **12 »**

518 **Douche** d'Esmarck, émaillé blanc, filets or ou fantaisie riche. . . . . . 2 — **12 »**
Les Douches avec couvercle en plus, par pièce. . . . . **2 »**

519 **Douches** en porcelaine, l'appareil complet 2 litres, **12** » . . . . . . 3 litres, **15 »**

520 **Canule-doucheur** à double courant, de Aran. . . . . **10 »**

521 **Canule-doucheur** en verre, avec obturateur en caoutchouc (fig. 199). . . . . **9 »**

Tous nos appareils pour injections sont comptés avec 2 mètres de tube en feuille anglaise rouge.

522 **Filière** Gaillard en carton (fig. 247) . . . . le cent. **7 »**

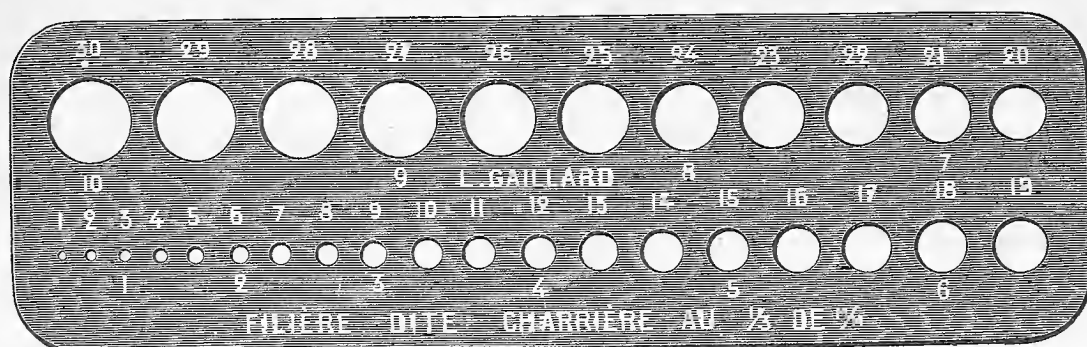


Fig. 246

523 **Filière** Gaillard en métal nickelé (fig. 246) échelle exacte au 1/3 de millimètres **8 »**

Trousse n° 1 d'urgence du docteur Bazy

6 **Bougies** à boule exploratrice, percées ou non percées, nos 8, 10, 13, 15, 18, 21.
4 **Bougies** olivaires filiformes, droites et tortillées.
9 **Bougies** coniques olivaires, nos 9 à 20.
4 **Sondes** coniques olivaires, nos 11, 13, 15, 17.
4 **Sondes** coudées à béquille, nos 14, 16, 18, 20.
6 **Sondes** molles de Nélaton, nos 14 à 19.
2 **Mandrins** métalliques, un coudé et un courbé.

Prix : **35** fr.

Dans un tube cristal avec gaine métallique. Prix : **43** fr.

Trousse d'urgence du Dr Noguès **30** », avec étui en nickel. . . . . **60 »**

Trousse n° 2, d'urgence

8 **Bougies** à boule exploratrice, nos 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. . . . . **10 »**
6 **Instillateurs** à boule perforée, de Guyon, nos 10, 12, 14, 16, 18, 20. . . . . . **7 50**
6 **Bougies** olivaires filiformes . . . . **6 »**
4 **Bougies** olivaires tortillées, intérieur crin de florence . . . . **6 »**
4 **Bougies** olivaires, armées, conductrices pour l'uréthrotome . . . . **8 »**
15 **Bougies** coniques olivaires, nos 7 à 21. . . . . **15 »**
12 **Sondes** coniques olivaires, nos 9 à 20. . . . . **15 »**
9 **Sondes** coudées à béquilles, nos 12 à 20. . . . . **11 25**
6 **Sondes** cylindriques droites, nos 15 à 20. . . . . **6 »**
9 **Sondes** Nélaton, nos 13 à 20 . . . . **6 75**
4 **Sondes** à bout coupé, en tissu de soie, pour uréthrotomie. . . . . **6 »**
2 **Mandrins** de Guyon, un courbe et un coudé. **7 50**

Prix : **95 »**

Trousse n° 3 pour praticien spécialiste

d'après les indications du professeur J. Albarran

18	**Instillateurs** à boule de Guyon, nos 7 à 24 (fig. 1)	22 50
24	**Bougies** à boule exploratrice, nos 6 à 24 (fig. 2)	30 »
12	**Bougies** olivaires filiformes, 2 séries (fig. 17)	12 »
8	**Bougies** olivaires filiformes tortillées, à l'intérieur crin de florence (fig. 24)	12 »
12	**Bougies** conductrices pour béniqué et uréthrotome (fig. 22 et 23)	24 »
24	**Bougies** coniques olivaires, nos 7 à 27 (fig. 31)	24 »
6	**Bougies** olivaires à extrémité souple, nos 12 à 24 (fig. 36)	7 50
18	**Sondes** coniques olivaires, nos 6 à 21 (fig. 60)	22 50
18	**Sondes** coudées à béquille, nos 12 à 24 (fig 69)	22 50
6	**Sondes** coudées à extrémité souple, nos 13 à 21 (fig. 71)	9 »
9	**Sondes** droites cylindriques, pour femme, nos 13 à 21 (fig. 62)	9 »
15	**Sondes** Nélaton à entonnoir, nos 12 à 21 (fig. 85)	15 »
6	**Sondes** irrigatrices d'Albarran, en soie, nos 12 à 24 (fig. 92)	15 »
8	**Sondes** bicoudées et olivaires courbes, nos 13 à 21 (fig. 73 et 75)	12 »
12	**Sondes** à bout coupé de Guyon, nos 15 à 21 en soie (fig. 90)	21 »
6	**Sondes** à demeure, à fixation automatique, modèle Gaillard, nos 16 à 26 (fig. 109)	12 »
12	**Sondes** urétérales d'Albaran, assorties (fig. 151 à 160)	36 »
3	**Conducteurs** modèle Gaillard, pour ces sondes urétérales (fig. 157 et 158)	20 »
2	**Mandrins** de Guyon, pour modifier la courbure des sondes	7 »

Prix : 310 fr.

Instruments et Appareils divers en caoutchouc médical pur pour la Chirurgie, la Médecine et l'Hygiène

524	**Alèses** ou drap d'hôpital, en toile caoutchoutée	le mètre	4 50
525	**Alèses** — caoutchouté à deux faces	—	7 »
526	**Alèses** pour enfant, en toile caoutchoutée, 1m ×75 c/m	—	8 »
527	**Alèses** — — avec poche et tube d'écoulement	—	12 »
528	**Alèses** pour adulte simple		12 »
529	**Alèses** — avec poche et tube d'écoulement		18 »
530	**Alèses** pour enfant, 70×80 c/m, simple, en caoutchouc feuille anglaise		18 »
531	**Alèses** — — avec tube et poche en caoutchouc		23 »
532	**Alèses** simples, pour adulte, en caoutchouc feuille anglaise		22 »
533	**Alèses** pour adulte, poche et tube d'écoulement, un mètre carré, en feuille anglaise,		30 »
	Anneaux Dumontpallier (Voir *Pessaires*, page 45).		

534 **Appareils** à 2 boules, pour pulvérisateur Richardson.

	n° 1	n° 2	n° 3	n° 4
Prix :	2 50	3 »	3 50	4 50

535	**Appareil** à 2 boules, de Richardson, grand modèle (fig. 251)	6 »
536	**Appareil** à 2 boules, de Richardson, caoutchouc fort et long tube pour soufflerie de thermocautère (fig. 251)	9 »
537	**Appareil** compresseur d'Esmarck, complet, tube en feuille anglaise rouge, avec bande tissu élastique pour amputation	20 »
538	**Tube** d'Esmarck, avec crochet et chaînette (fig. 250)	12 »
539	**Bande** pour compression, du Dr Nicaise	7 50
540	**Appareil** à extension et contre-extension, complet	28 »
541	**Aspirateur** simple, du Dr Potain	50 »



Fig. 250

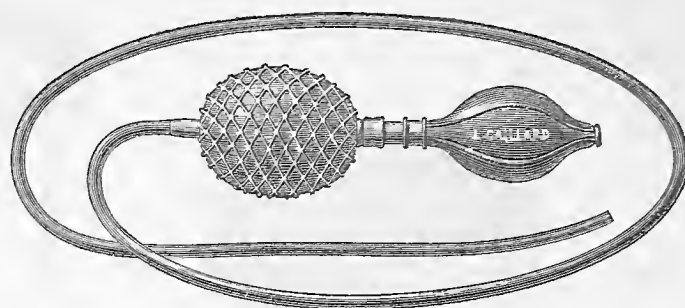


Fig. 251

542 **Aspirateur** double, du Dr Potain . . . . **60** »
543 **Aspirateur** à 2 aiguilles et 3 trocarts, du Dr Dieulafoy. . . . . **42** »
544 **Aspirateur** du Dr Dieulafoy, grand modèle, 3 trocarts, 4 aiguilles et 2 robinets. **55** »
545 **Inhalateur** d'oxygène du Dr Dupont, appareil complet . . . . **52** »

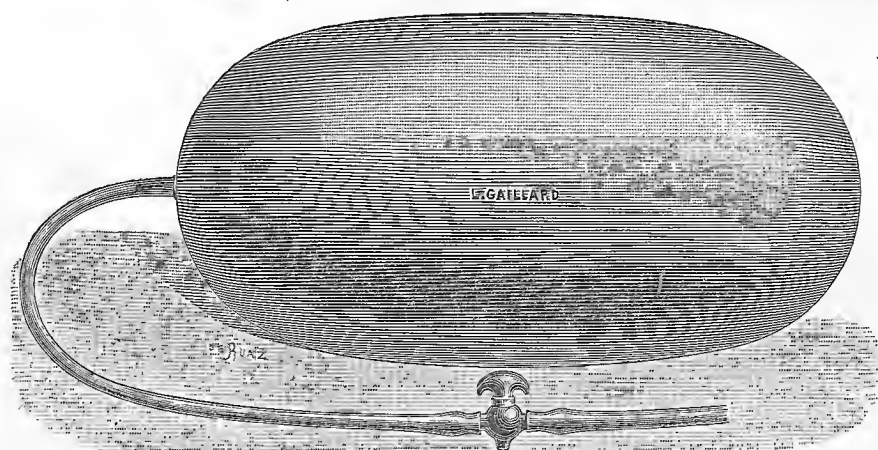


Fig. 252

546 **Ballons** ou sac à gaz oxygène, avec robinet (fig. 252).

Contenance :	10	15	20	25	30	40 litres.
Prix :	**15** »	**18** »	**20** »	**22** »	**25** »	**35** »

547 **Robinet** en deux pièces avec bague, en cuivre nickelé . . . . **3** »
548 **Ballons** de Pétersen, pour la taille, de 300 à 700 gr. . . . . **7** »
549 **Ballons** de Champetier de Ribes, pour accouchement prématuré, petits modèles, nos 1 à 6 . . . . **6** »



Fig. 253

550 **Ballons** de Champetier de Ribes, grands modèles, avec robinet (fig. 253) . . 9 à **12** »

551 **Ballon** du Dr Tarnier, grand modèle . . . . 6 »
552 **Sonde** pelote à tamponnement vaginal, du Dr Tarnier . . . . 2 »




Fig. 254




Fig. 255

553 **Bandage** ombilical en caoutchouc feuille angl. pure, pour enfant 30 à 55 c. (fig. 254) 4 »
554 — — — pur pour cadet (fig. 254), 55 à 75 centim. 6 »
555 — — — pour adulte, 75 centimètres et au-dessus, 9 à 12 »
556 **Bandage** en caoutchouc simple ou double, pour enfant (fig. 255). 4 50
557 **Bandage** en caoutchouc pour cadet, simple . . . . 7 »
558 — — — double 8 50

Bandages herniaires à ressort forgé

		SIMPLES			DOUBLES			OMBILICAUX		
		Adulte	Cadet	Enfant	Adulte	Cadet	Enfant	Adulte	Cadet	Enfant
559	Bonne qualité ordinaire.	5 »	4 »	3 50	9 »	7 »	5 »	7 50	6 »	4 50
560	Confortable pour fatigue	7 50	5 »	» »	12 »	9 »	» »	9 »	7 »	» »
561	Qualité demi-fine.	10 »	7 50	5 »	15 »	12 »	8 »	12 »	9 »	7 »
562	Qualité fine, en peau.	15 »	10 »	7 »	20 »	15 »	10 »	18 »	12 »	9 »
563	Recouverts en caoutchouc.	15 »	10 »	7 »	20 »	15 »	10 »	18 »	12 »	9 »

Bandages recouverts, en gomme, de L. Gaillard (voir page 47)

564 **Bande** en caoutchouc, feuille anglaise, pour pansement . . . . le kilo 22 »

Largeur en centimètres :	5	6	7	8	10	12
Le mètre :	1 75	2 »	2 50	3 »	3 75	4 50

565 **Bande** à pansement en caoutchouc, feuille anglaise, rouge ou noire. . . le kilo 25 »

Largeur en centimètres :	5	6	7	8	10	12
Prix :	2 »	2 50	3 »	3 50	4 25	5 »

566 **Bande** forte en caoutchouc médical, pour contre-extension. . . . . . . le kilo 25 »

Largeur	5	6	7	8
Prix :	3 50	4 »	4 50	5 »


567 **Bande** du Dr Championnière, en caoutchouc médical pur, longueur 1m50 largeur 0m035, épaisseur 3 millimètres . . . . 4 »

Bas élastiques pour varices, Tissu Français, Anglais et Français, à côtes

		Coton.	Coton fin.	Demi-soie.	Soie.
568	Bas simple.	8 »	10 »	14 »	18 »
569	Genouillère.	7 »	9 »	11 »	15 »
570	Molletière	6 »	8 »	10 »	12 »
571	Chaussette	5 »	6 50	8 »	10 »
572	Cuissard	7 »	9 »	12 »	15 »
573	Bas à genouillère.	15 »	18 »	22 »	26 »
574	Bas à genouillère et cuissard. . . .	20 »	25 »	30 »	35 »

Articles en caoutchouc, feuille anglaise, pour varices ou eczéma


575 **Bas simple** en caoutchouc, feuille anglaise . . . . 10 »
576 **Chaussette** — — . . . . 5 »
577 **Chausson** — — 3 50
578 **Molletière** — — . . . . 7 »
579 **Genouillère** — — . . . . 7 »
580 **Cuissard** — — . . . . 8 »
Caleçon et camisole en caoutchouc contre l'obésité, prix suivant mesures.
581 **Bassins** ronds en cuir bouilli, pour malades, trois grandeurs, à. . . . 8, 10 et 12 »
582 **Bassins** ronds en gutta-percha, pour malades, trois grandeurs, à . . 11, 13 et 15 »


Fig. 256

583 **Bassins** forme pelle, émaillé très soigné (fig. 256) . . . . de 10 à 18 »


Bassins ou cuvettes pour pansements



Fig. 257


Fig. 258

584 **Bassins** pour pansement, réniforme en caoutchouc (fig. 257). . . . . . nº 1 5 »
— — — — nº 2 6 »
— — — — nº 3 7 »
585 **Bassins** à pus, en caoutchouc durci, forme de cœur ou trèfle (fig. 258) 7 50


Fig. 259


Fig. 260


Fig. 261

586 **Cuvette** à pansement, en cristal, forme haricot dit réniforme (fig. 259), nº 1 2 75
— — — — . . . . nº 2 4 »
— — — — . . . . nº 3 5 50
587 **Cuvette** à pansement, en cristal, forme cœur (fig. 260) 6 50
588 **Cuvette** à pansement, en cristal, forme trèfle. 6 50
589 **Cuvette** à pansement, en cristal, forme ovale (fig. 261). . . . . 4 »
590 **Bassin** émaillé blanc réniforme, suivant grandeurs . . . . de 2 à 5 »
591 **Bassin** — — forme cœur 4 50
592 **Bassin** — — forme trèfle, 2 grandeur. . . . . 3 et 5 »

593	**Baudruche** en feuilles . . . . la douz. de feuilles 6 », le cent.	38 »
594	**Biberons**, parfait nourricier, ou autres modèles . . . . de 2 à	3 50
595	**Bocaux** ovales en cristal, avec capuchon caoutchouc, pour pièces anatomiques.	8 »
596	**Bocaux** ronds en cristal, prix suivant dimensions	» »
597	**Bonnets** à glace, en caoutchouc, feuille anglaise, pour enfant. . . à un courant	7 »
598	— — — . . . . à deux courants	8 50
599	**Bonnets** à glace en caoutchouc, feuille anglaise, pour homme . à un courant	8 »
	— — — — — . à deux courants	10 »
600	**Bonnets** de bains en caoutchouc pur, forme calotte, pour enfant ou cadet (fig. 262)	2 50
601	**Bonnets** de bains, en caoutchouc pur, à oreillettes pour homme ou pour femme (fig. 262) . . . . la pièce 4 50, la douz.	33 »
602	**Bonnets** de bains, en caoutchouc pur, plissé, pour femme. . . 5 », la douz.	36 »
603	**Bonnets** de bains en taffetas gommé pour enfant . . . . —	18 »
604	— — — — façonné pour femme . . à 3 50, la douz.	30 »
605	**Bonnets** de bains satinette, façonné pour femme. . . . . . à 3 50, la douz.	30 »
606	**Bouts** de sein, verre et caoutchouc, de Bailly . . . . la douz.	4 50
607	**Bouts** de sein tout caoutchouc . . . . la douz.	6 »
608	**Bouts** de sein en gomme noire . . . . la douz.	9 »
609	**Bouts** de sein en taffetas ou baudruche collodionné, contre les gerçures, la paire	3 »
610	**Calottes** en caoutchouc, feuille anglaise pure (fig. 262) . . . . la douz.	24 »
611	— — fort — . . . . la douz.	30 »
612	**Ceintures** abdominales en tissu élastique, pour grossesses et autres, de 6 à	25 »
613	**Cornets** acoustiques en gomme noire.	3 »
614	**Cornets** acoustiques divers et à tuyau conducteur . . . . de 4 à	10 »
615	**Coussin** cervical en caoutchouc pur pour torticolis	12 »
616	— — — avec insufflateur	15 »




Fig. 262


Fig. 263




Fig. 264

617	**Coussins** ronds en tissu imperméable, pour voyage . . . . 12, 15 et	18 »
618	**Coussins** forme oreiller ou demi-rond (fig. 263) . . . . 9, 12, 15 et	18 »
619	**Coussins** ronds en caoutchouc, feuille blanche. . . . . . diamètre 35 centim.	7 »
	— — — — . . . . . . diamètre 40 centim.	9 »
620	**Coussins** forme bidet. . . . . 15, 18 et	21 »
	— — caoutchouc pur, feuille anglaise . . . . 22, 27 et	32 »
621	**Coussins** ronds en caoutchouc feuille anglaise pure (fig. 264), diam. 35 c/m.	15 »
	— — — — . . . diamètre 40 centim.	18 »
622	**Coussins** demi-rond — — . . . diamètre 45 centim.	25 »
623	**Coussin** en fer à cheval, en caoutchouc, feuille anglaise pure, de 15 à	25 »
624	**Doigtiers** en caoutchouc, assortis . . . . la douz.	2 50
625	**Douches** d'Esmarck (Voir *Appareils pour injections,* page 55).	
626	**Doigtiers** condom, en baudruche, pour toucher rectal ou vaginal . . . la douz.	3 »



Fig. 265

627 **Drains** du Dr Lucas Championnière, en caoutchouc rouge, moulés et préparés (fig. 265).

Long. 15 cent. diam.	3 à 5	6 à 8	9 à 10	11 à 12	13 à 15 millim.
	» 60	» 70	1 25	1 60	2 »
628 Long. 25 cent. diam.	3 à 5	6 à 8	9 à 10	11 à 12	13 à 15 millim.
	» 75	1 »	1 50	2 »	2 50




Fig. 266

629 Série de 9 drains du Dr L. Championnière, de 4 à 12 mill., 15 cent. de longueur, en tube cristal (fig. 266). . . . . **12** »

630 Série de 9 drains du Dr L. Championnière, 4 à 12 mill., 25 cent. de longueur, en tube cristal (fig. 266). . . . . **15** »



Fig 267

631 **Drains en cristal incassable, pour drainage parfait et antiseptie constante, modèle Gaillard** (fig. 267) . . . . **9** »

Grosseurs de 5 à 10 millimètres.				Grosseurs de 11 à 18 millimètres.			
Long. 9 cent.	à 6 œils	latéraux, la douz.	**7 50**.	Long. 9 cent.	à 6 œils	latér., la douz.	**9** »
— 12	— 9	— —	**9** »	— 12	— 9	— —	**12** »
— 15	— 12	— —	**10 50**	— 15	— 12	— —	**15** »

Les drains parfaits modèle Gaillard sont livrés par série ou douzaine assorties à la demande en boîte carton.

La figure 267 représente nos drains réduits d'un tiers, la longueur normale est de 9 à 15 centimètres. Nous les faisons à 6, 9 ou 12 trous pour les plaies de profondeurs différentes, et de 5 à 15 millimètres; sur demande, nous en faisons de plus gros calibre.



Fig. 268

632 **Drain** utérin du Dr Vaux, modèle Gaillard (fig. 268), 10 numéros à . . . . . . **3** »

633 **Tube** en croix ou en T, du Dr Pozzi, pour drainage utérin. . . . . **3** »

634 **Drap** d'hôpital (Voir aussi *Alèses*) . . . . le mètre **4 50**

635 — — double face . . . . **7** »

636 **Etagère** pour instruments, 4 montants nickelés avec pieds, 3 tablettes glaces 35×50, hauteur à la demande. . . . . **135** »

637 **Etagère**, 3 tablettes glaces 40×60, hauteur à la demande . . . . **160** »

638 **Etagères** pour instruments, tous autres modèles, prix suivant dimensions.

639 **Gants** pour friction, en flanelle . . . . la paire, de **3** à **4 50**

640 — — en crin végétal, assortis . . . . la paire, de **3** à **7** »

641 **Lanières** pour frictions. . . . . de **5** à **8** »




Fig. 269




Fig. 270

642	**Gants** moulés en caoutchouc, pour eczéma (fig. 269)	la paire	7 »
643	**Gants** en caoutchouc, feuille anglaise pure, pour anatomie ou laboratoire,	la paire	8 »
644	**Gants** en caoutchouc pur, avec manchettes (fig. 270) ou sans boutons	la paire	9 »
645	— — avec manchettes et avant-bras	la paire	12 »
646	— — avec avant-bras, feuille forte	la paire	15 »
647	**Gants** sans doigts, dits mouffles	la paire	6 »
648	— — — avec avant-bras	la paire	10 »
649	**Gants mouffles** avec avant-bras, feuille forte	la paire	14 »
650	**Gutta-percha** laminée, dit taffetas, en feuille, le mètre **3 50**	le kilo	25 »
651	**Gutta-percha** en plaque, pour moulage et appareils	le kilo	22 »
652	— — qualité supérieure	le kilo	28 »
653	**Injecteur** nickelé boule caoutchouc	petit modèle	3 »
654	— — —	moyen modèle	4 50
655	— — —	grand modèle	6 »
656	**Injecteur** tout nickelé, à piston	petit modèle	4 50
657	— — —	grand modèle	7 »
658	— Enéma caoutchouc gris		3 »
659	— — — rouge		4 50
660	— — — glacé, dit américain		6 »
661	— — — tube, jet continu		6 »

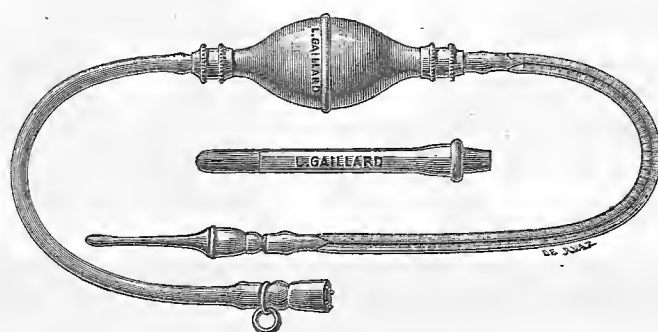


Fig. 271

662	**Injecteur** tout caoutchouc, Alpha véritable, à jet continu (fig. 271)		9 »
663	**Irrigateur** Eguisier, bonne qualité	n° 2, 1/2 litre	8 »
664	— — —	n° 3, 1 litre	12 »
665	**Irrigateur** Eguisier, corps étain fin	n° 2, 1/2 litre	12 »
666	— — —	n° 3, 1 litre	18 »
667	**Irrigateur** Eguisier, nickelé	n° 1, 1/4 litre	12 »
668	— — —	n° 2, 1/2 litre	15 »
669	— — —	n° 3, 1 litre	20 »
670	**Irrigateur** Eguisier, en porcelaine	n° 2, 1/2 litre	18 »
671	— — —	n° 3, 1 litre	24 »
672	**Tube** de rechange complet, pour ces irrigateurs		2 50

673 **Boîte** acajou pour transporter ces irrigateurs . . . . 3 et 4 »
674 . **Insufflateur** lance-poudre, balle caoutchouc rouge . . . . 3 à 5 »




Fig. 272

675 **Lance-poudre** pour iodoforme petit modèle (fig. 272). . . . . 6 »

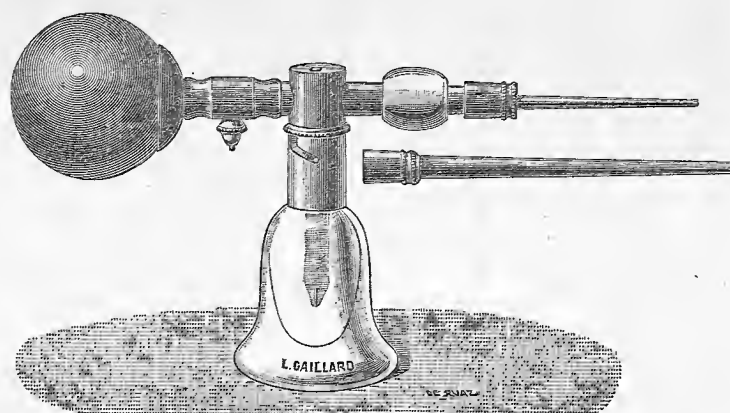


Fig. 273

676 **Lance-poudre** pour iodoforme grand modèle avec pied (fig. 273). . . . . . . 10 »
677 **Masque** moulé en feuille anglaise, contre l'eczéma, pour enfants 5 50
678 **Masque** moulé en caoutchouc pur, contre l'eczéma, pour adulte. . . . . 7 »
679 **Masque-sac** à éther pour l'anesthésie. 10 50




Fig. 274




Fig. 275

680 **Matelas** hydrostatique capitonné, à air ou à eau, en caoutchouc pur, feuille anglaise forte, modèle des hôpitaux (fig. 274),

Dimensions en centimètres :	35 × 50	40 × 60	50 × 70	60 × 80	70 × 90	80 × 105 c/m
Prix :	35 »	45 »	55 »	70 »	90 »	120 »

681 **Matelas** en tissu caoutchouté :

Dimensions en centimètres :	50 × 70	65 × 110	80 × 160	110 × 180
Prix :	50 »	65 »	90 »	125 »

682 **Pelote** à tamponnement nasal, avec robinet 2 50
683 **Pelote** ou **sonde** de Tarnier, pour tamponnement vaginal, avec robinet 2 50
684 **Pelote** hémorroïdale, avec coussin sous-cuisse et ceinture (fig. 275) . . . . . . 10 »




Fig. 276

685 **Pelote** périnéale, en feuille anglaise (fig. 276) avec ceinture . . . . 7 »

Pessaires divers (Voir page 44).

686 **Pessaire** releveur de Borgner (fig. 210) avec ceinture, comme fig. 275. . . . . 15 »
687 **Pessaire** avec tige et sous-cuisse. . . . . 9 »
Plateaux à rebords en tôle émaillée pour laboratoire, suivant dimensions, de 3 à 8 »
688 **Poires** en caoutchouc moulé gris, monture corne ou caoutchouc durci, canule os pour lavement urèthre ou injection (fig. 276) :

Nos	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Cont. : gr.	25	40	60	85	120	145	185	230	260	320	400	430	480
Prix :	1 25	1 50	2 »	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »	5 50	6 »	6 50	7 »

689 **Poires** en caoutchouc rouge moulé, même contenance que la série ci-dessus (fig. 277).

N°	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Prix :	1 50	2 »	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »	5 50	6 »	6 50	7 »	8 »



Fig. 277

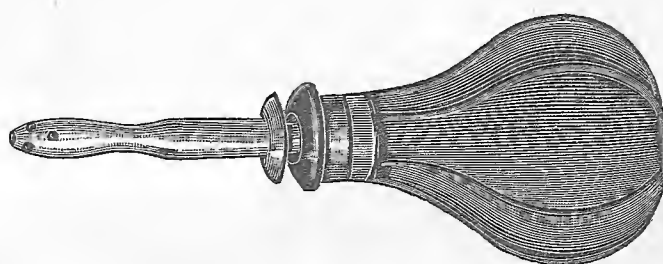


Fig. 278

690 **Poires** vernies à côtes, noires, rouges ou vertes (fig. 278).

Nos	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16
Prix :	2 50	3 »	3 50	4 »	4 75	5 50	6 50	7 50	8 »	9 »

691 **Poires** à côtes en caoutchouc pur, feuille anglaise, prix suivant contenance.
692 **Poires** tout caoutchouc, moulé rouge :

Nos	1	2	3	4	5	6	7
Prix :	1 50	2 »	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50

693 **Poire** de Pollitzer, pour insufflations nasales, à 1 canule. 8 50
694 — — — — à 2 canules. . . . . 10 »
695 **Préservatifs** en caoutchouc, 1re qualité, n° 1 . . . . la douz. 4 », la grosse 30 »
— — 2e qualité, n° 2 . . . . — 3 50 — 24 »
— — 3e qualité, n° 3 . . . . — 3 » — 18 »
— — 4e qualité, n° 4 . . . . — 2 50 — 15 »
Ces prix s'entendent livraison roulés en boîte par douzaines. Livrés en paquets de cigarettes, en plus. . . . . par grosse 1 50
696 **Préservatifs** spermophiles dits à sucette . . . . . . la douz. 3 50, la grosse 24 »
697 **Préservatifs** dits bout américain . . . . — 3 » — 18 »
698 **Préservatifs** en baudruche, droits ou courbes 1re qualité extra soufflée la douz. 6 », la grosse 51 »

699	**Préservatifs** droits ou courbes, baudruche, 2e qual. extra, la douz.	**5** », la grosse		**42**	»
700	— — — — — —		—	**27**	»
701	**Anneaux** dentelés en caoutchouc pur, feuille anglaise	— **3 50**	—	**24**	»

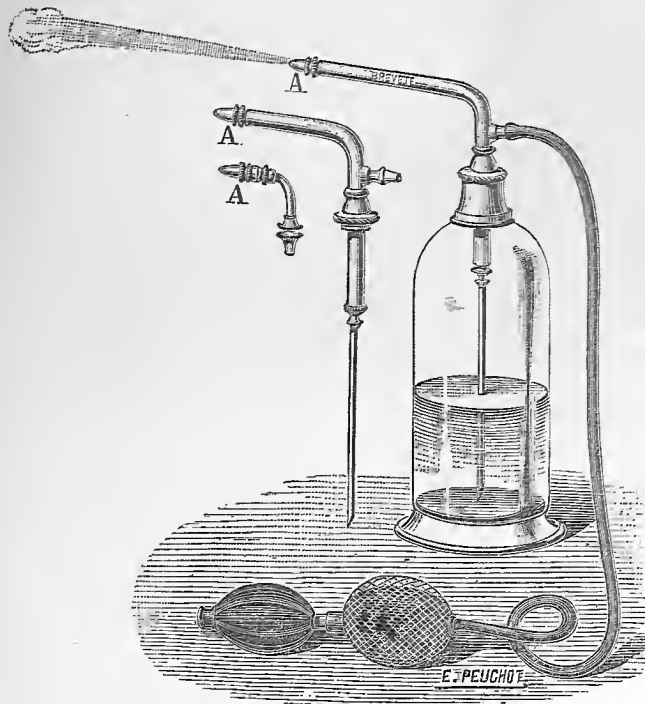


Fig. 279

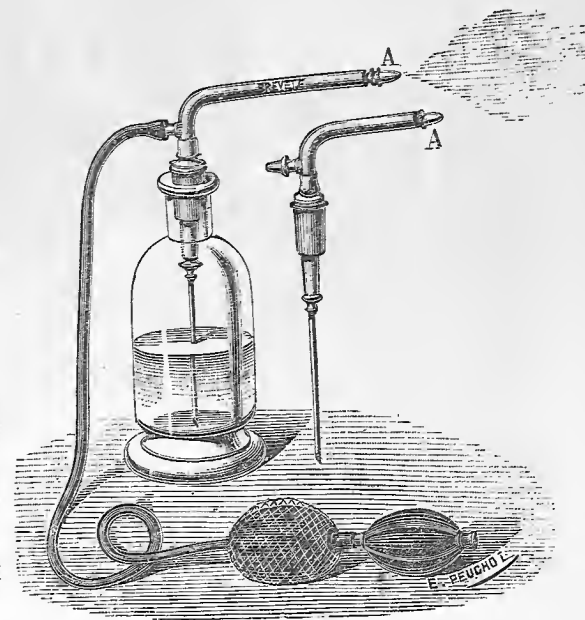


Fig. 280

702	**Pulvérisateur** Richardson, grand modèle (fig. 279), monture nickelée, à jet réglable, carafe contenant 300 grammes.	**9**	»
703	**Pulvérisateur** Richardson, universel monture nickelée, à jet réglable (fig. 280)	**7**	»
704	**Pulvérisateur** — — — (fig. 280), petit modèle	**5**	»
705	**Pulvérisateur** Richardson, flacon carré, monture coudée pour pulvérisation naso-pharyngienne. . . . . prix	**10**	»
706	**Pulvérisateur** Richardson monture caoutchouc durci, à . . . **3 50**, **4 50** et	**6**	»
707	**Pulvérisateur** à vapeur, petit modèle dit parisien. . . . . à **7 50** et	**9**	»

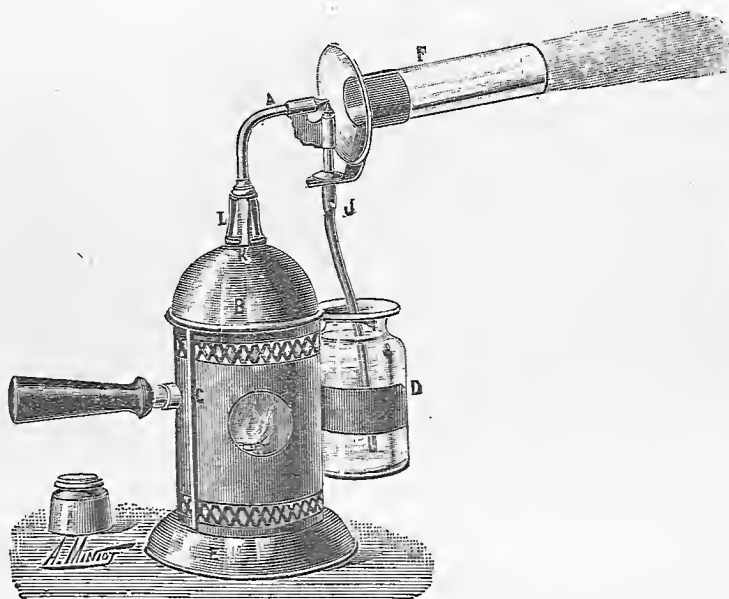


Fig. 281

708	**Pulvérisateur** parisien à vapeur, grand modèle, avec entonnoir (fig. 281) . .	**12**	»

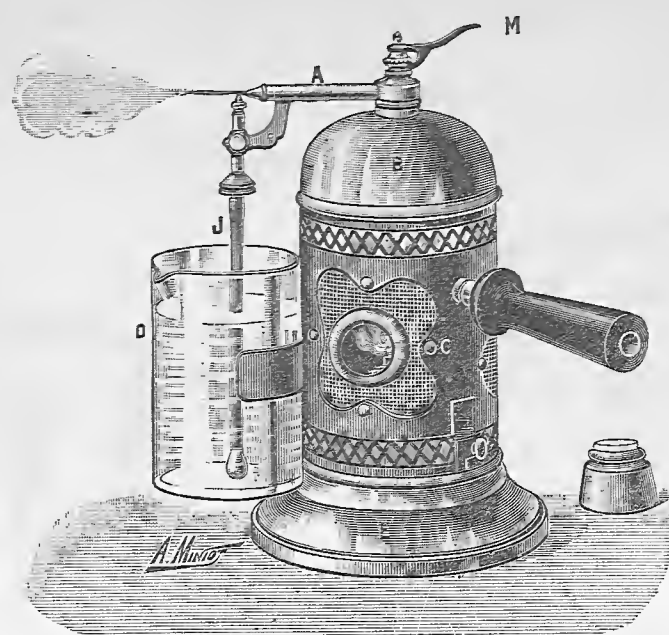


Fig. 282

709 **Pulvérisateur** à vapeur, modèle riche et confortable (fig. 282) . . . . 18 »
710 — — avec robinet — . . . . 24 »
711 **Pulvérisateur** à vapeur, du Dr Lucas Championnière, petit modèle. . . . . . . 45 »
712 — — — — un seul jet marchant 1 h. 1/2 68 »
713 — — — — à 2 jets, 1 heure et demie 75 »
— — — -- à 2 jets marchant 2 h. 1/2 82 »
714 — — — — grand modèle marchant 4 heures 95 »
715 **Robinets** divers, caoutchouc durci et cuivre nickelé, et presse-tube de tous modèles.
Sacs à gaz (Voir *Ballons à gaz*).
716 **Seringues** pour sérum, du Dr Roux

gr.	1	2	3	4	5	10	15	20
Prix :	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	15 »	18 »	21 »

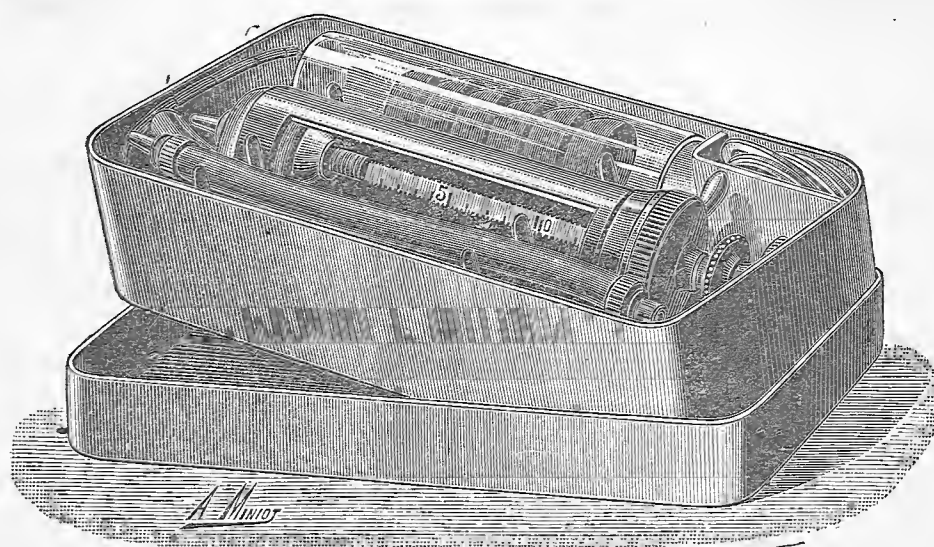



Fig. 283


717 **Seringues** pour sérum, en boîte métal stérilisable (fig. 283) :

gr.	1	2	3	4	5	10	15	20
Prix :	12 »	13 »	14 »	16 »	18 »	22 »	23 »	28 »

718 **Seringues** hydrocèles, pour plaies ou vésicales (Voir page 53).

719 **Seringue** de Pravaz, 2 aiguilles, en boîte gainerie . . . . 5 »
720 — — — un flacon en boîte . . . . 7 »
721 **Seringue** Pravaz, 2 aiguilles, en boîte cerclée, genre porte-monnaie. . . . . . 8 »


Fig. 284

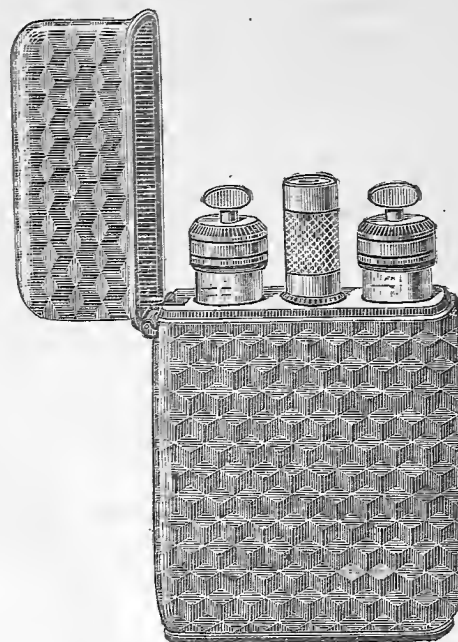
Fig. 285

722 **Seringue** Pravaz, 2 aiguilles et un flacon, boîte cerclée, genre porte-monnaie (fig. 284) 10 »
723 **Seringue** Pravaz, 2 aiguilles et un flacon, en trousse. . . . . 10 »
724 — — 2 aiguilles, en boîte métal à ressort . . . . 11 »
725 **Seringue** Pravaz, 2 aiguilles et un flacon, en boîte métal . . . . 15 »
726 **Seringue** Pravaz, 3 aiguilles et 2 flacons, en boîte métal. . . . . 20 »
727 **Seringue** Pravaz, 3 aiguilles en étui, 2 flacons, en boîte métal (fig. 285). . . . . 22 »
728 **Seringue** Pravaz, 3 aiguilles 3 — — à ressort . . . . 25 »
729 **Seringue** Pravaz, 2 aiguilles 1 flacon, boîte métal, genre tabatière. . . 12 »
730 **Seringue** pour trousse, 3 aiguilles, 1 flacon, dans un étui métal . . . . 12 »
731 **Seringue** Pravaz, contenant 5 gr., 2 aiguilles pour médecine vétérinaire . . . . 9 »

Toutes ces seringues peuvent être livrées en argent contrôlé, avec augmentation de 75 à 100 p. 0/0 des prix annoncés ci-dessus.

732 **Aiguilles** en platine irridié pour seringues de Pravaz,

longueur en centimètres	2 1/2	3	4	5
	3 »	4 »	5 »	6 »

733 **Siphon** du Dr Weber, pour douches nasales complet, avec poire d'amorcement. 7 »
734 **Siphon** de Weber simple 4 50
735 **Siphon** du Dr Potain, pour lavages de la plèvre avec canule simple. . . . . 9 »
736 **Siphon** — — avec canule double. 10 50
737 **Spéculum** grillagé pour bain. . . . . 3 »
738 **Spéculum** en caoutchouc durci, pour bains. 2 50
739 **Spéculums** à valves, assortis. . . . . 12 à 25 »
740 **Stéthoscopes** en buis et caoutchouc durci, assortis . . . . 2 50 à 8 »
741 **Suspensoirs** en tricots, divers. . . . . de 1 50 à 4 »
742 — — à poche mobile . . . . de 2 50 à 5 »
743 **Suspensoirs** en caoutchouc pur, feuille anglaise 3 50
744 **Taffetas** gommé, largeur 0m80 . . . . le mètre 2 25
745 **Taffetas** collodion. 2 50
746 **Taffetas** chiffon, largeur 0m70 à 0m80 . . . . le mètre 7 et 9 »

747 **Tétines** en feuille anglaise noire ou rouge, la douz., n° 1, **1 50**; n° 2, **1 75**; n° 3, **2 »**; n° 4 **2 50**
748 **Tétine** ou **Téterelle** pour bouteille . . . . la douz. **3 50**, la grosse **30 »**
749 **Tétine** coudée débile ou autre modèle pour bouteille — **6 »**, — **48 »**
750 **Téterelle** du Dr Auvrard . . . . la douz. **30 »**
751 **Téterelle** du Dr Budin . . . . — **30 »**
752 **Tire-lait** simple avec poire caoutchouc . . . . la pièce **2 50**, la douz. **21 »**





Fig. 286

753 **Tire-lait** atmosphérique . . . . petit modèle **2 50**, grand modèle (fig. 286). **4 »**
754 **Tire-lait** Mathers . . . . la pièce **2 50**, la douz. **18 »**
755 **Thermomètre** à maxima, étui buis . . . . **3 »**
756 **Thermomètre** étui caoutchouc durci. . . . . **4 »**


Fig. 287

757 **Thermomètre** étui nickelé, uni ou guilloché (fig. 287). . . . . **4 »**
758 — — à maxima . . . . **5 »**
759 **Thermomètre** pour bains, à flotteur. **2 50**
760 **Toile** caoutchoutée ou drap d'hôpital, 0m90 de large. . . . . le mètre **4 50**
761 — — — sur deux faces, 1m10 de large. . . . . . **7 »**
762 **Tube** en caoutchouc pur, feuille anglaise, gris, noir ou rouge

diam. extér. m/m	2 à 4	5 à 7	8 et 9	10 et 11	12 et 13	14 et 15
le mètre	**» 80**	**1 25**	**1 50**	**2 »**	**2 50**	**3 »**
le kilo	**50 »**	**42 »**	**35 »**	**32 »**	**30 »**	**28 »**

763 **Tube** à drainage, en caoutchouc rouge ou noir, pur feuille anglaise à paroi épaisse, que nous fournissons aux hôpitaux de Paris.

	nos 6 à 21,	21 à 24,	25 à 30,	31 à 45,
Le mètre	**1 »**	**1 50**	**2 »**	**3 »**

le 45 a 15 millim.

764 **Tubes** à drainage préparés par bouts de 20 c/m, en flacons cristal 12 drains assortis **7 »**
Série de tubes à drainage préparés, de 3 à 12 millimètres, sans flacon. . . . . . **5 »**
765 **Drains** moulés en caoutchouc vulcanisé pur, du Dr Lucas Championnière, douz. **12 »**
766 Série de drains du Dr Lucas Championnière, en tube cristal. . . . . **15 »**
767 **Drain** parfait en cristal, modèle Gaillard (fig. 267), la douz. assorties . . . . . **9 »**
Tubes pour lavages de l'estomac (voir page 38).
768 **Tube** caoutchouc rouge pur, en forme de pipe, spécial pour douche, bock, laveur 1m 50 de longueur.. . . . . **2 50**
769 **Tube** caoutchouc gris, pour gaz ou laboratoire. . . . . le kilog. **12 »**

Diam. extér.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20 m/m
Le mètre	**» 70**	**» 85**	**1 »**	**1 20**	**1 40**	**1 60**	**1 80**	**2 »**	**2 25**	**2 50**	**2 75**	**3 »**

770 **Tube** caoutchouc rouge, 1re qualité, pour gaz ou laboratoire . . . . . le kilog. **15 »**

Diam. extér	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
Le mèt.	**» 80**	**1 »**	**1 25**	**1 50**	**1 75**	**2 »**	**2 25**	**2 50**	**2 75**	**3 »**	**3 25**	**3 50**

771 **Tuyaux** d'arrosage ou autres avec toiles . . . . le kilog. **10** »


Diamètre intérieur	10	12	15	18	20	23	25	28	30
Prix du mètre	**2** »	**2 50**	**3** »	**3 50**	**4** »	**4 50**	**5** »	**5 50**	**6** »

Diam. intér.	35	40	45	50 millim.
Le mètre	**6 75**	**7 50**	**8 25**	**9** »

Les prix de ces tuyaux sont basés pour une bonne épaisseur proportionnée à la grosseur ; ils peuvent varier suivant l'épaisseur indiquée et le nombre de toiles.

Urinaux portatifs de jour et de nuit en caoutchouc pur

Modèles que nous fournissons aux hôpitaux de Paris

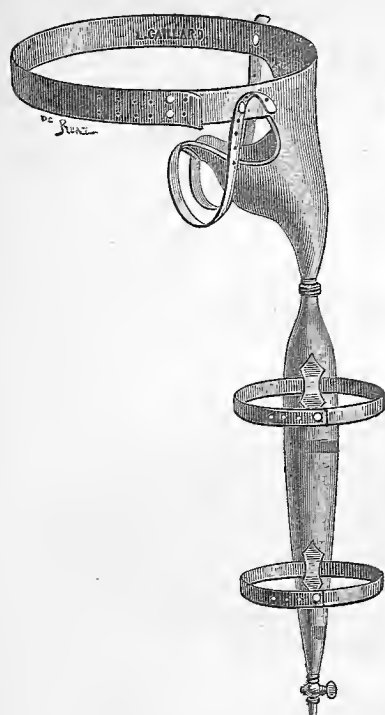

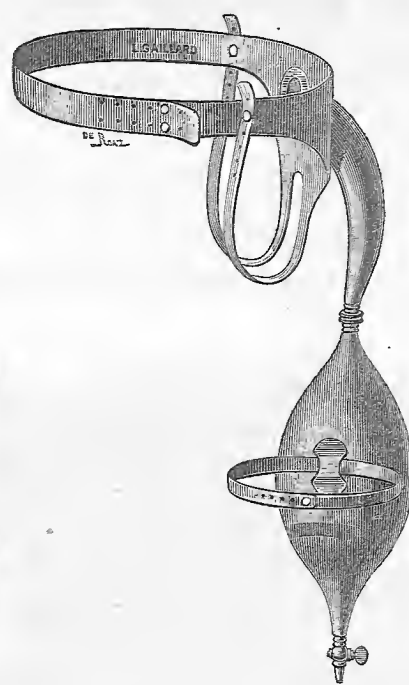




Fig. 288 Fig. 289 Fig. 290

772 **Urinal** pour homme à ceinture et sous-cuisses, poche longue ou ronde . . . . . **8** »
773 **Urinal** pour homme, sous-cuisses et suspensoir poche longue ou ronde (fig. 288). **10** »
774 — — à ceinture et double suspensoir (fig. 288). . . . . **15** »
775 **Urinal**, appareil pour extrophie de la vessie. . . . . **25** »
776 — — spécial, pour vieillard ou infirme . . . . **18** »
777 **Urinal** de nuit pour homme, avec ceinture poche et tube intermédiaire . . . . **12** »
778 **Urinal** de nuit pour homme, avec ceinture et poche longue ou ronde (fig. 289). **12** »
779 **Urinal** de nuit pour homme, avec ceinture, suspensoir à obturateur . . . . **15** »
780 **Urinal** de nuit pour homme, avec ceinture et suspensoir et tube intermédiaire **15** »
781 **Urinal** de jour simple, pour enfant **4 50**
782 **Urinal** de jour pour enfant, avec ceinture, sous-cuisses et poche . . . . **7** »
783 **Urinal** de nuit pour enfant, avec ceinture, poche et obturateur. . . . . **9** »
784 **Urinal** de jour, simple, pour femme. **9** »
785 **Urinal** de jour, à ceinture et bavette, pour femme (fig. 290). . . . . **12** »
786 **Urinal** pour homme, en caoutchouc recouvert de toile. . . . . **20** »
787 **Urinal** pour femme, en caoutchouc recouvert de toile . . . . **25** »
788 **Urinal** de nuit, en caoutchouc pour femme. . . . . **22** »

Urinaux pour le lit

789 **Urinal** pour le lit, en caoutchouc moulé, pour homme . . . . 6 »
790 **Urinal** de lit pour hommes, en caoutchouc, à crochet et tube. . . . . 12 »
791 **Urinal** de lit pour femme, en caoutchouc moulé. . . . . 9 »
792 **Urinal** moulé ovale, en caoutchouc souple . . . . 7 »

Fig. 291 Fig. 292 Fig. 293

793 **Urinal** en verre, pour homme, modèle simple (fig. 291). 2 50
794 **Urinal** en verre, pour homme modèle spécial pour recueillir les dépôts de gravier (fig. 292). . . . . 10 »
795 **Urinal** en verre, pour femme, modèle spécial (fig. 293). . . . . 3 »
796 **Ventouses** moulées, tout caoutchouc. . . . . 1 50 à 3 »
797 **Ventouses** en cristal, montées sur balle caoutchouc . . . . 1 50 à 3 50
798 **Verres** gradués pour dosage des médicaments suivant contenance de . . . 2 à 6 »
799 **Vessie** à éther pour l'anesthésie . . . . 10 »

Fig. 294

800 **Vessie** à glace en caoutchouc pur, modèle ordinaire,

Diamètres :	16	18	21	24	27	30	35	centimètres.
	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »	6 »	

801 **Vessie** à glace en caoutchouc, rondes, monture bois, avec bouchon, 4, 5 50 et 7 »
802 — — — (fig. 294) bouchon et monture métal à vis, 5, 6 50 8 »
803 — — — ovales, monture bois avec bouchon.

Diamètres :	15 × 19	18 × 23	21 × 27	25 × 30	30 × 35
	3 50	4 25	4 75	6 »	7 »

804 **Vessie** à glace en caoutchouc ovale, monture métal à vis, en plus par pièce . » 75
805 — — — plissée, avec monture et bouchon métal à vis, petite. 6 »
806 — — — — — — moyenne. 8 »
807 — — — — — — grande. 10 »
808 **Vessie** à glace plissée en tissu caoutchouté. . . . . petite. 3 »
809 — — — — — . . . . moyenne. 4 »
810 — — — — — . . . . . grande. 5 »
811 **Vessie** à glace en caoutchouc, pour le dos . . . . petite. 9 »
812 — — — — — . . . . moyenne. 12 »
813 — — — — — . . . . . grande. 15 »
814 **Vessie** à glace en caoutchouc, simple pour les yeux . . . . 2 »
815 **Vessie** à glace en caoutchouc, double pour les yeux . . . . 4 »

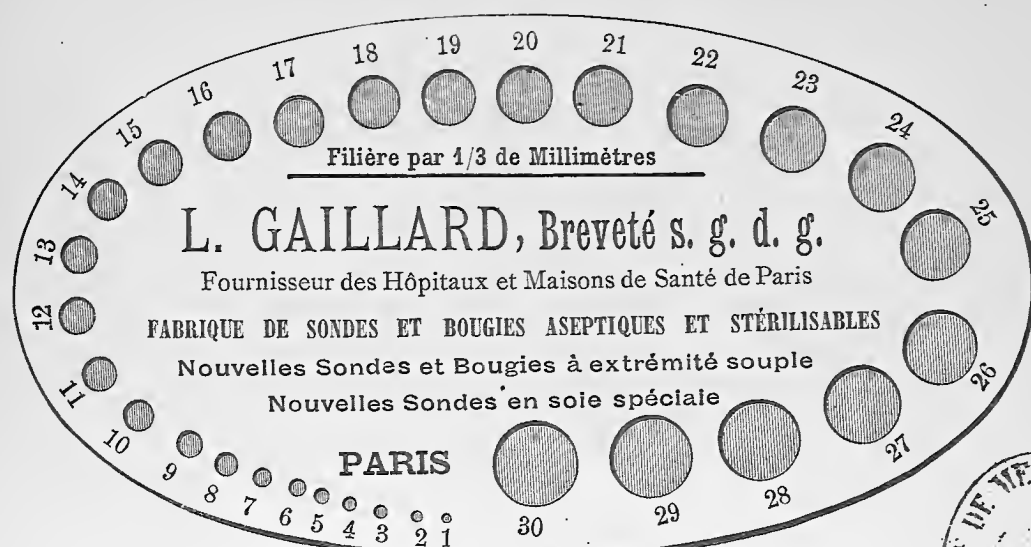


Fig. 247

Filière Gaillard, en carton



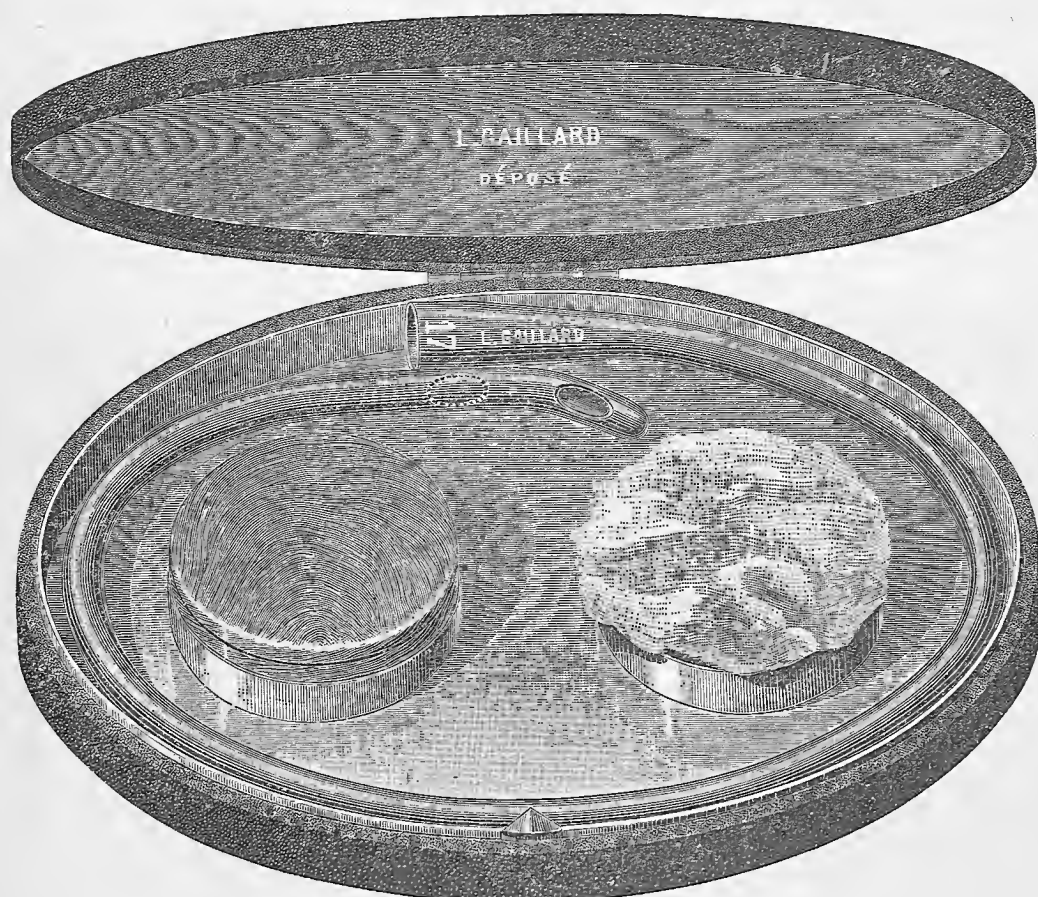


Fig. 223

Boite à sonde, pour la poche

TABLE DES MATIÈRES

Maladies des voies urinaires

Exploration et Diagnostic

Instruments pour franchir les rétrécissements

Instruments pour la dilatation

Uréthrotomie interne

Rétention d'urine. Sondes uréthrales en général

Blennorrhagie, instillations caustiques, lavages

Rein, Cystoscopie, Voies urinaires supérieures

Estomac, Œsophage, Sondes et Canules


Instruments et appareils divers pour voies urinaires

Instruments et Appareils divers en caoutchouc médical pur

Tours. — Imp. Paul Bousrez.

Conservation et stérilisation garantie en tous pays des Sondes et Bougies L. Gaillard

Sonde en tissu de Soie

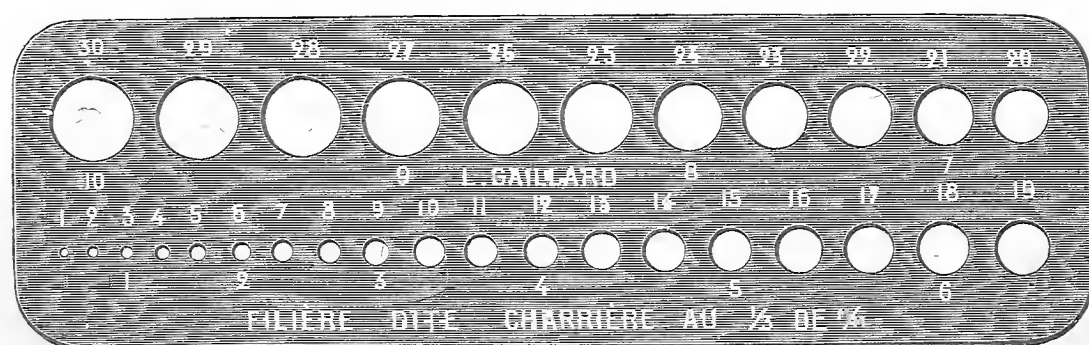

Filière en métal nickelé, modèle Gaillard, donnant la série très exactement graduée

Seule la marque L. GAILLARD offre toute les garanties, l'exiger sur chaque instrument

Tours, imprimerie Paul Bousrez.